NU SKIN®
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™

S3

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER

ANVÄNDARMANUAL

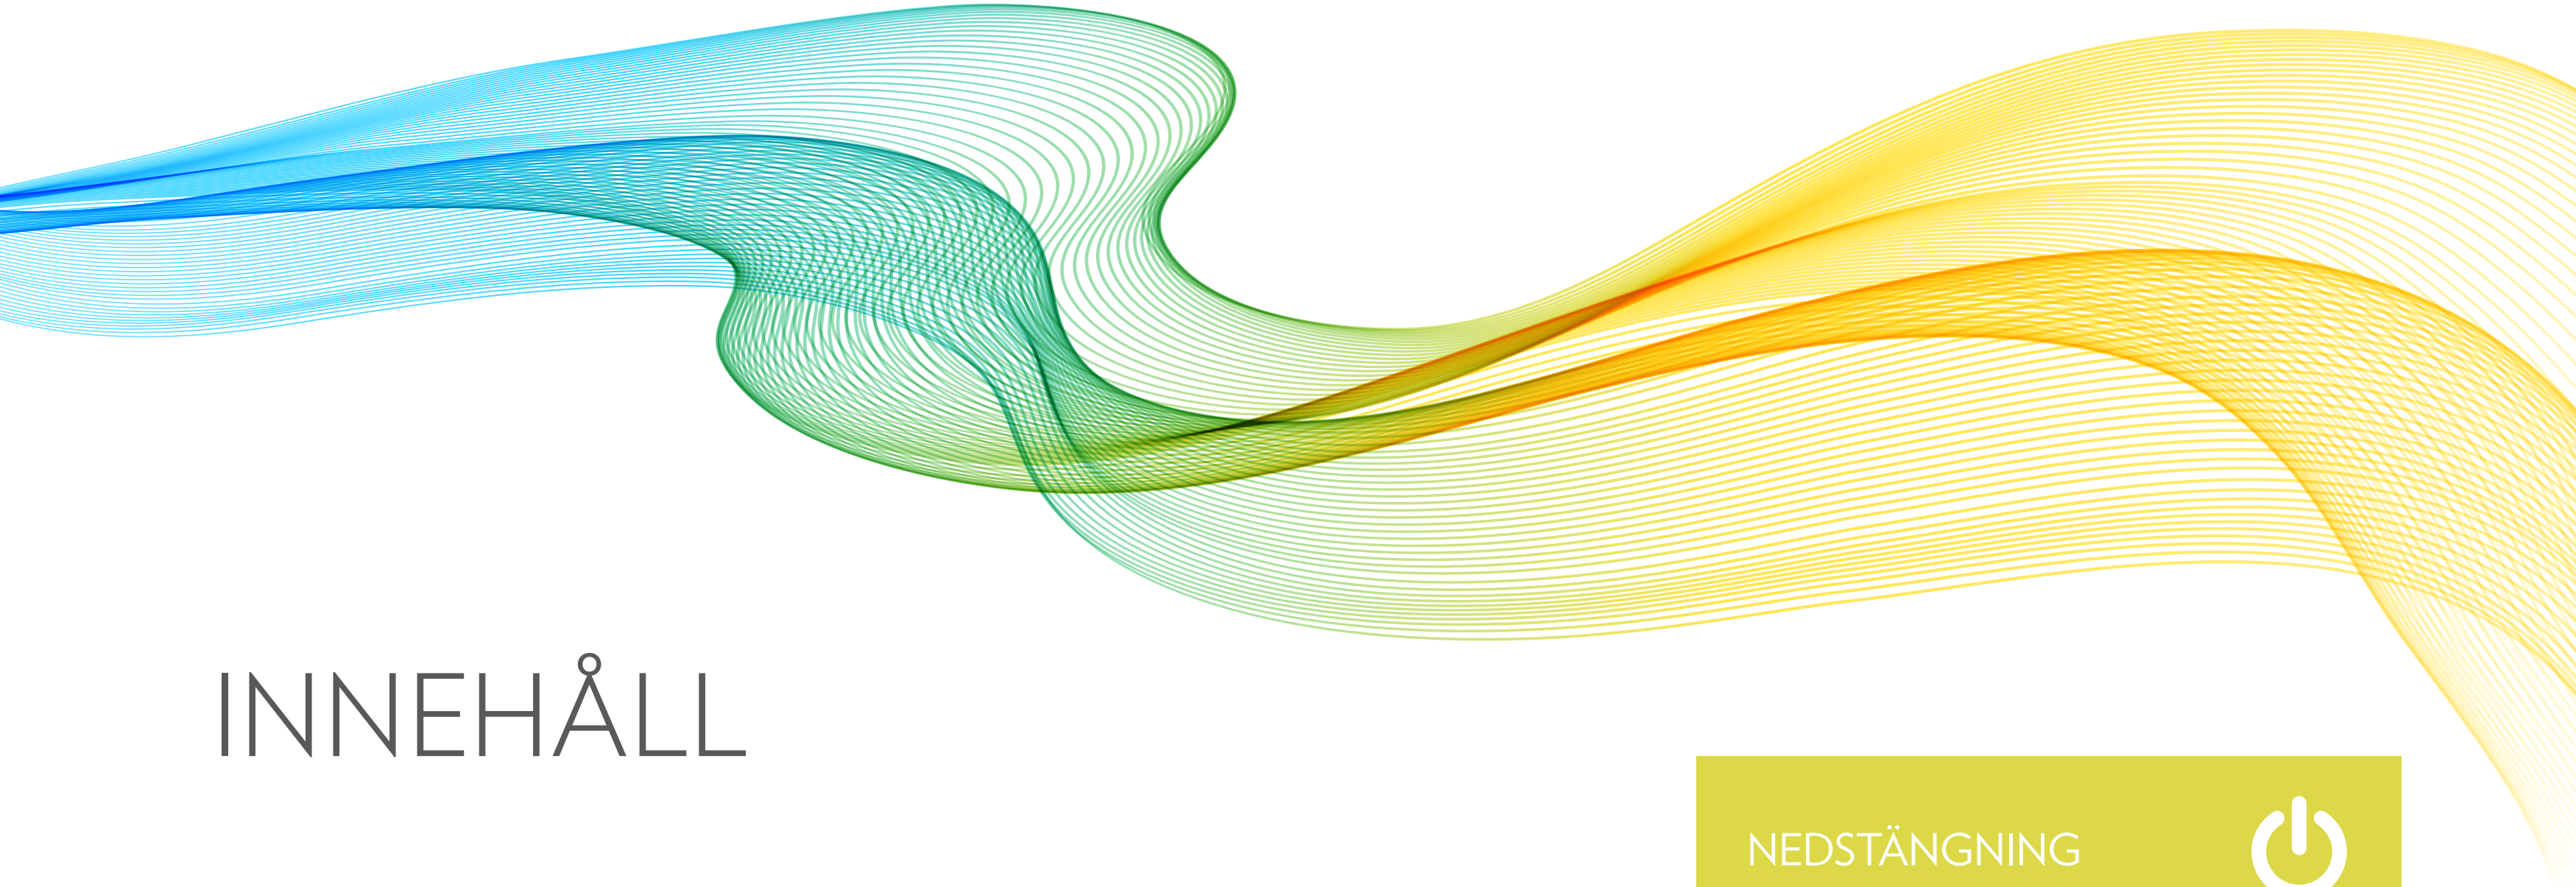

INNEHÅLL

ÖVERSIKT
SÄKERHETSINFORMATION
VIKTIGT ATT VETA
SÄTT IGÅNG DIN S3
SKANNA MED S3
SYNKRONISERA DIN S3
NEDSTÄNGNING
SUPPORT
TIPS & RÅD
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ÖVERSIKT

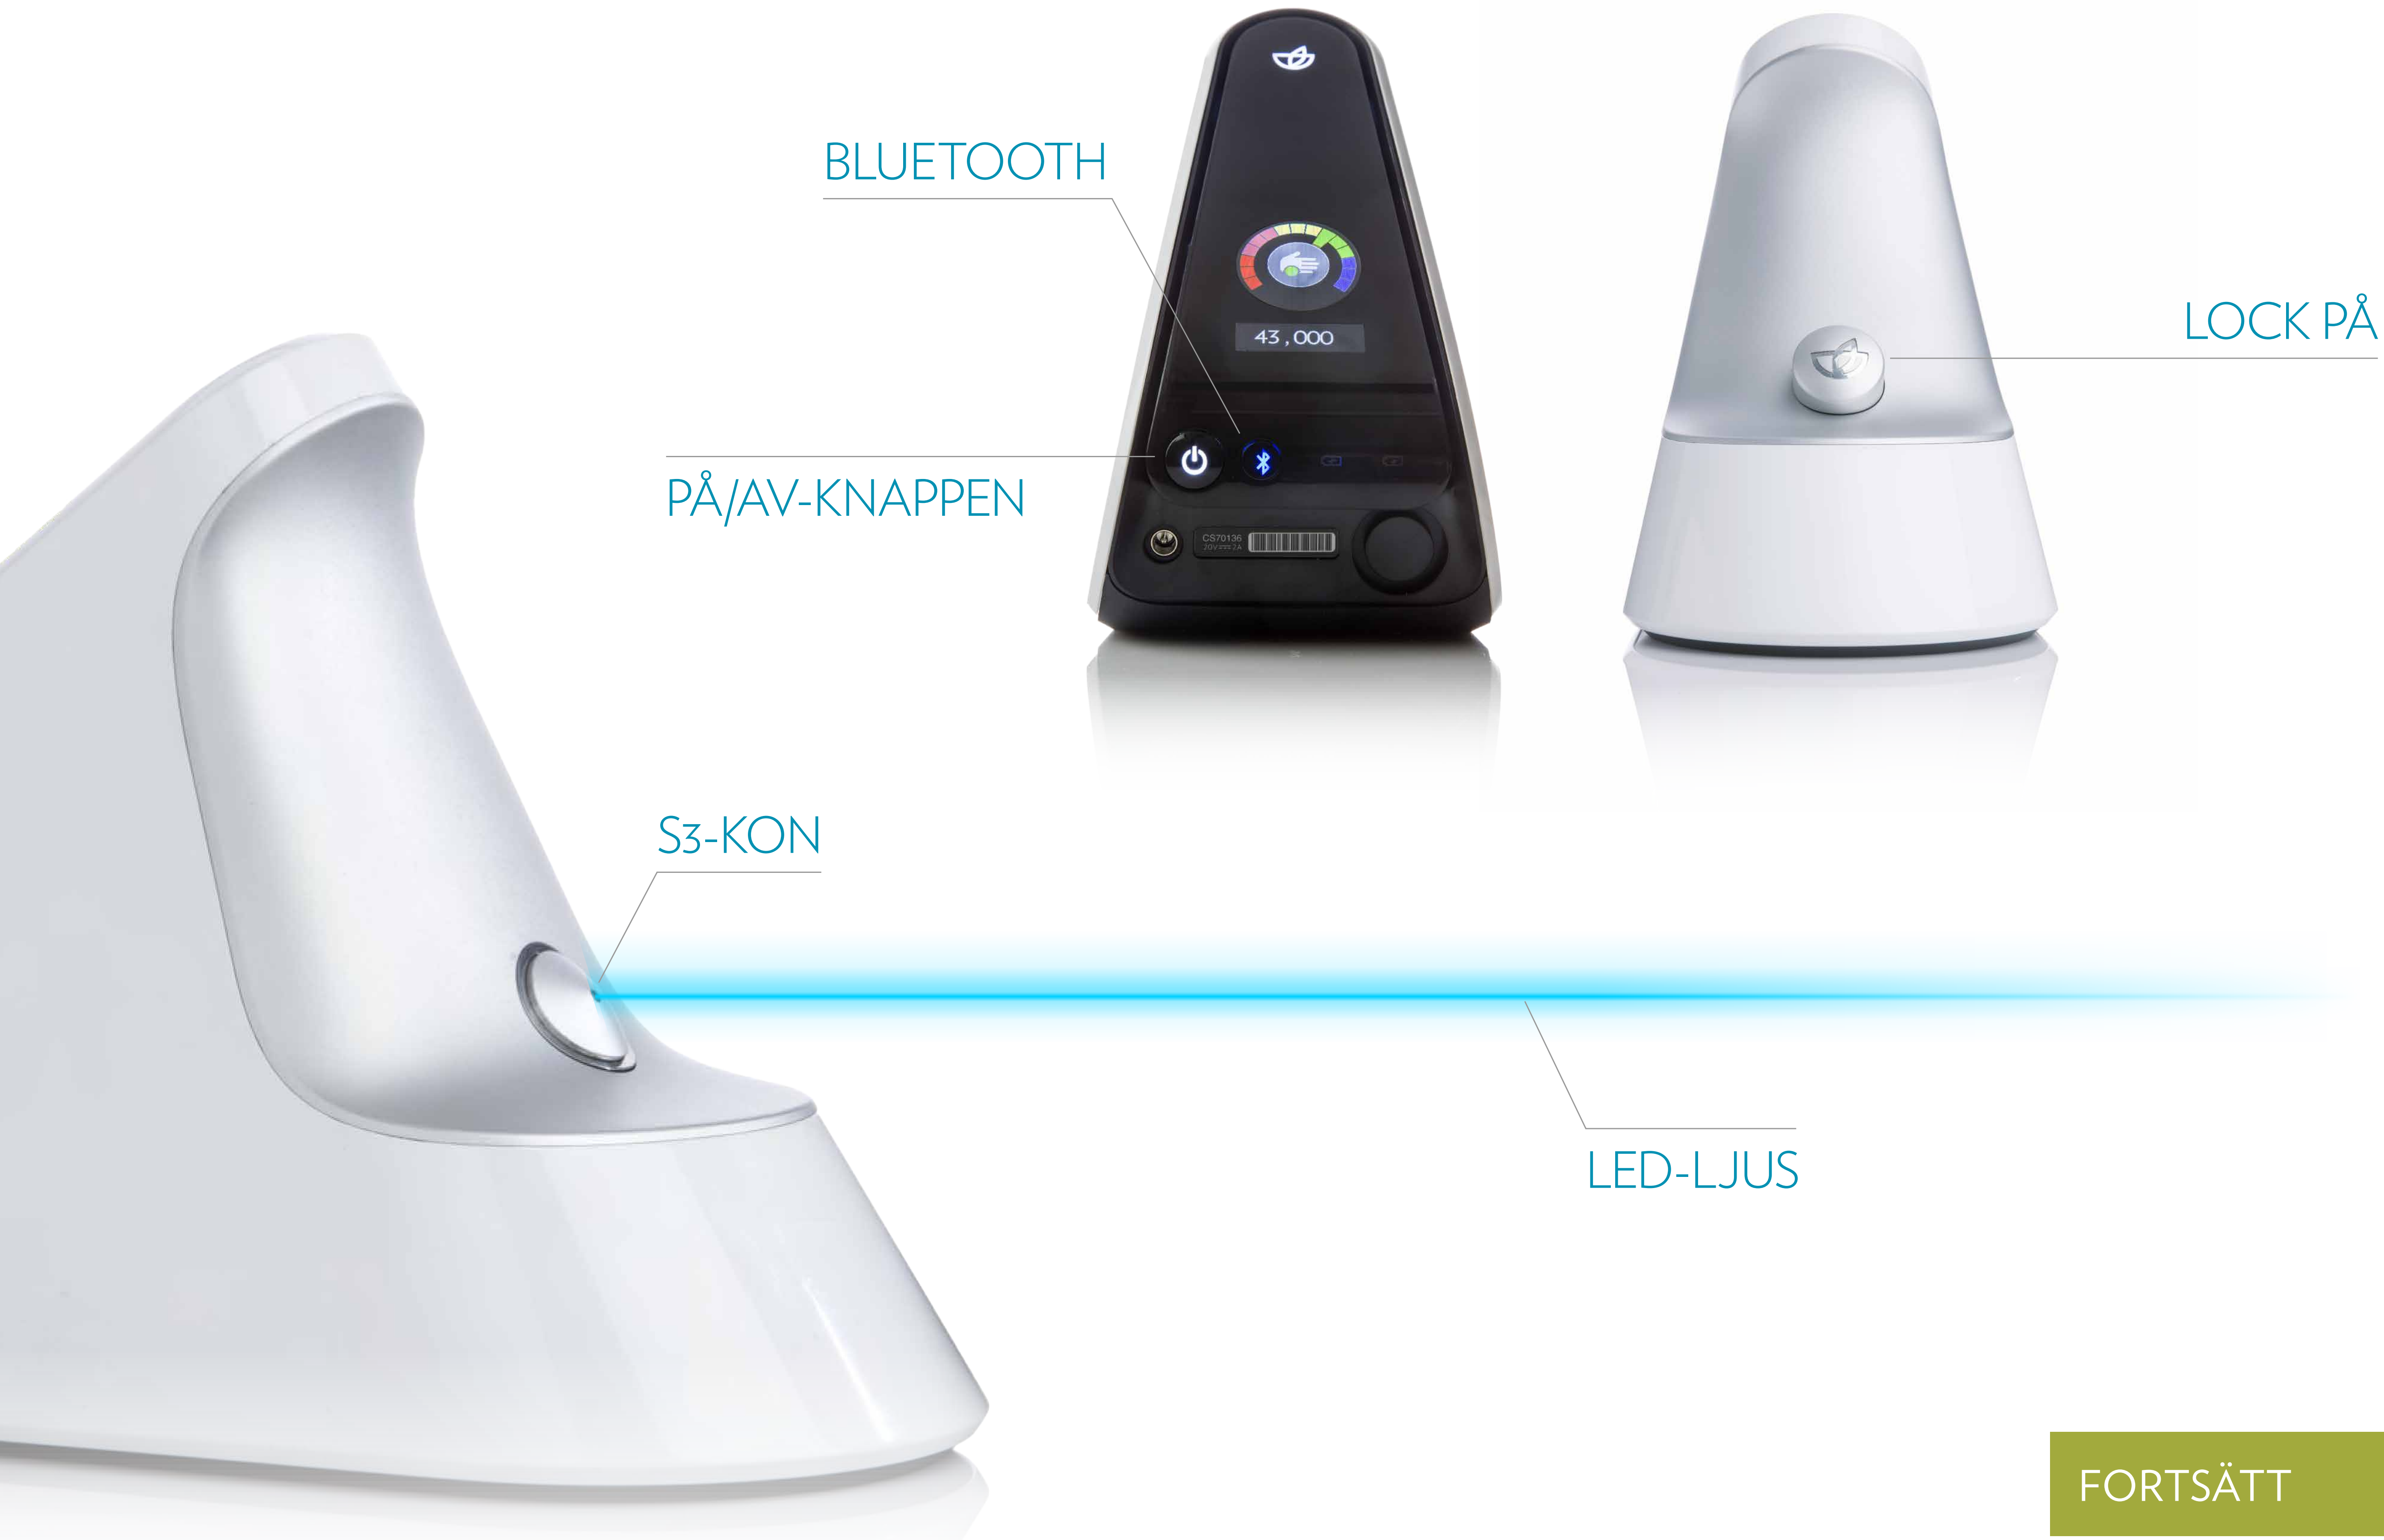
BLUETOOTH
43,000
PÅ/AV-KNAPPEN
LOCK PÅ
S3-KON
LED-LJUS

FORTSÄTT >

SÄKERHETSINFORMATION

HANTERING
ELVARNING
ALLMÄNNA VARNINGAR
UNDERHÅLL

VARNING:
Om man inte följer säkerhetsinstruktionerna kan det leda till eldsvåda, elstöt eller andra skador på S3, iPad mini eller annan egendom. Läs igenom hela manualen och säkerhetsinstruktionerna innan du använder S3 för att säkerställa korrekt användning.

HANTERING

Skannern är ett mycket känsligt vetenskapligt instrument.
Hantera den alltid varsamt.

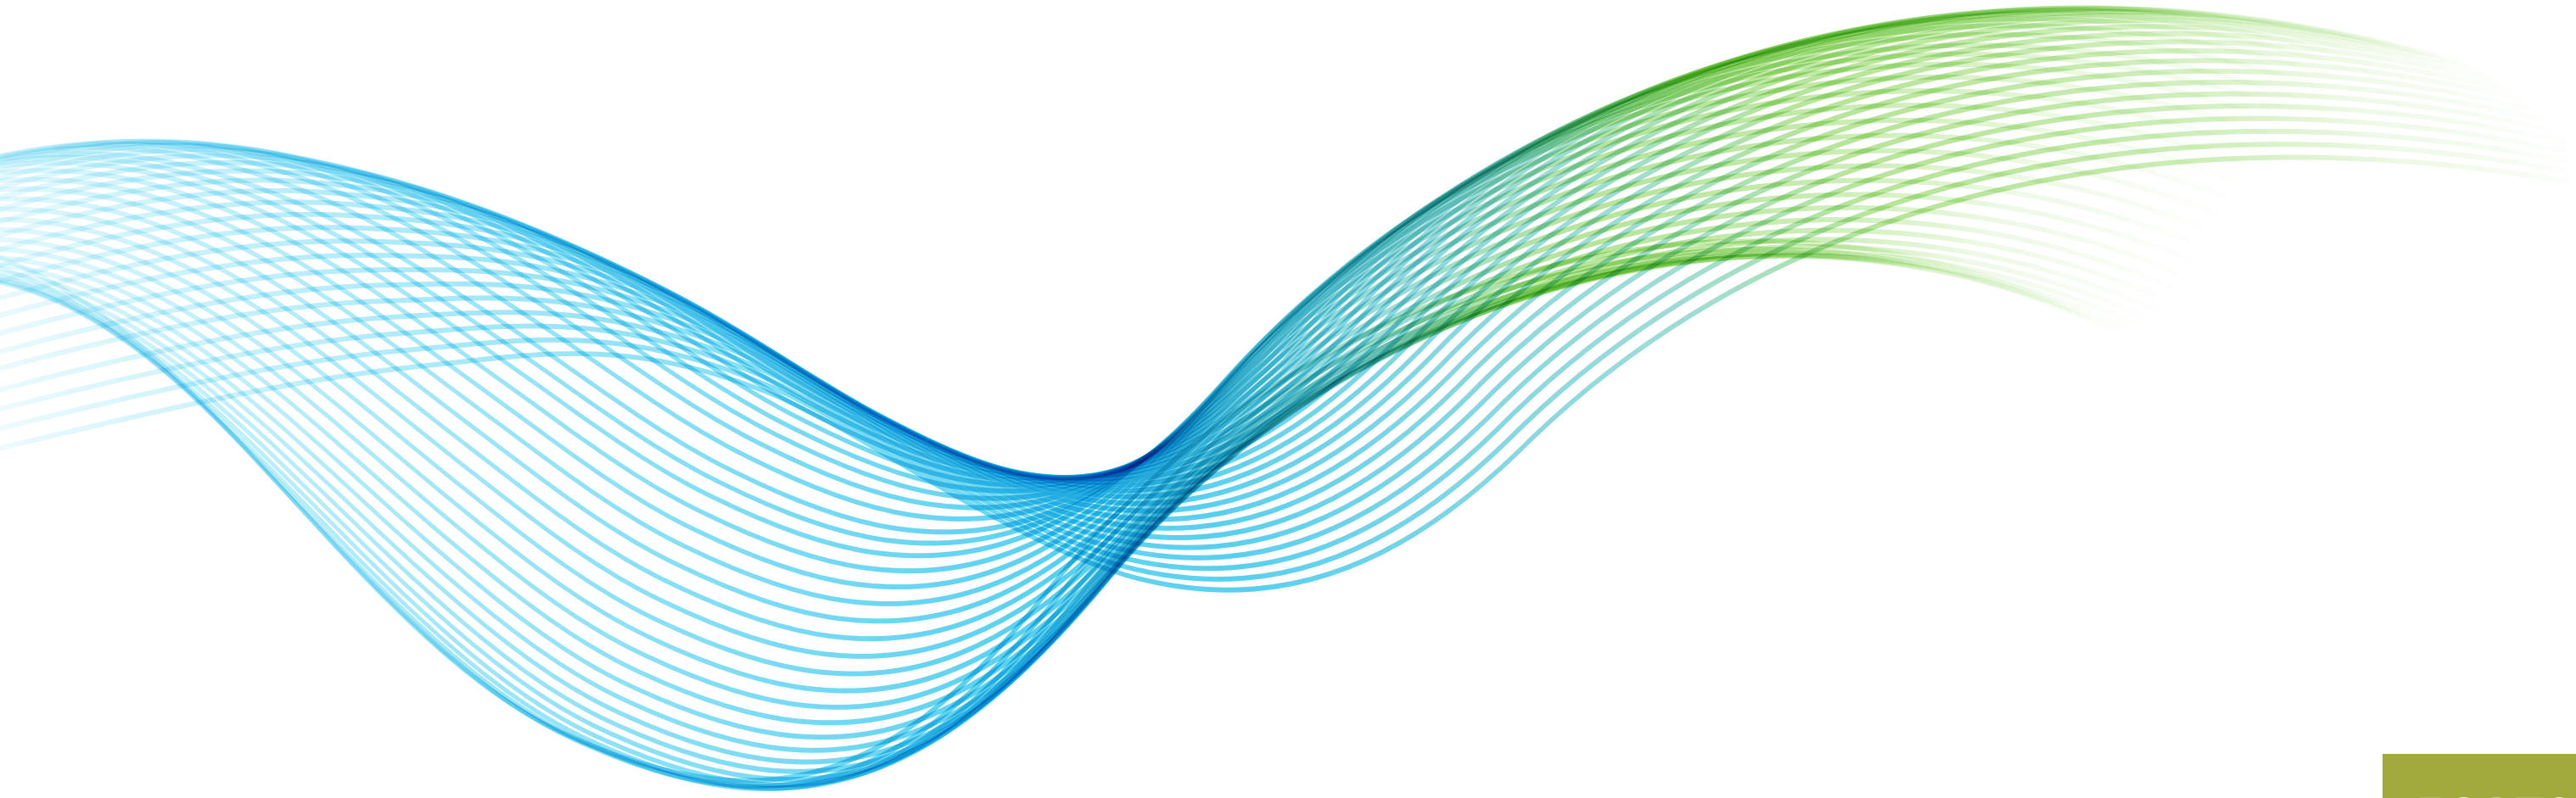

FORTSÄTT >

HANTERING
ELVARNING
ALLMÄNNA VARNINGAR
UNDERHÅLL

ELVARNING

A. VATTEN & FUKT

Minska risken för eldsvåda eller elstöt, utsätt aldrig S3 för regn eller fukt.

Använd aldrig S3 nära vatten, såsom badkar, handfat, diskho, tvättmaskin, i fuktig källare, nära swimmingpool eller dylikt. Om vätska spills ut på eller nära S3, koppla omedelbart ur S3 från eluttag och kontakta lokalkontoret. Om S3 inte är inkopplad men går på batteri, rör inte apparaten utan kontakta lokalkontoret.

B. UNDERHÅLL

Avlägsna inte skyddskåpan eller underdelen av S3 för att försöka reparera den själv. Du kan skada dig och apparaten om du försöker plocka isär den. Det finns inga utbytbara delar inuti. Underhållsarbete ska endast utföras av kvalificerad tekniker hos Pharmanex®.

FORTSÄTT >

HANTERING
ELVARNING
ALLMÄNNA VARNINGAR
UNDERHÅLL

ELVARNING

C. SLADDAR & ELUTRUSTNING

Använd ingen annan nätledning eller strömtillförsel än de som medföljer S3. Överbelasta inte eluttag eller skarvsladdar. En jordad kontakt passar bara med ett jordat uttag med matchande kontakter. Behöver du en förlängningssladd så använd en jordad sådan.

D. NEDKYLNING

S3 ska aldrig placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla. Undvik att förvara utrustningen i för varma eller kalla miljöer någon längre tid. Den optimala förvaringstemperaturen ligger mellan 10° - 40°C.

FORTSÄTT >

HANTERING
ELVARNING
ALLMÄNNA VARNINGAR
UNDERHÅLL

ALLMÄNNA VARNINGAR

A. AKTA ÖGONEN

Skannern använder sig av LED-ljus. LED återfinns i hushållsutrustning, elektronik och vanliga ficklampor. Även om de normalt inte är skadliga för ögonen så rekommenderas att inte se direkt in i ljuskällan eller annan ljuskälla på nära håll någon längre tid.

B. KÄNSLIGA OPTISKA KOMPONENTER

Optiken i S3 kan skadas om den utsätts för mycket skarpt ljus. Skanna inte blanka, spegelliknande föremål eller metallföremål som reflekterar ljuset tillbaka in i S3. Skanna inte några extrema objekt överhuvudtaget. Rikta inte S3 mot kraftig rumsbelysning eller solljus. Täck skannerns kon med locket när du inte använder S3 eller då skannern exponeras för skarpt ljus. Följer du inte dessa rekommendationer kan de känsliga optiska komponenterna i S3 skadas.

FORTSÄTT >

HANTERING
ELVARNING
ALLMÄNNA VARNINGAR
UNDERHÅLL

ALLMÄNNA VARNINGAR

C. BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Denna enhet får endast användas såsom Pharmanex® specificerat. Säkerheten hos apparaten kan skadas om så ej sker.

D. ANSLUTANDE ENHET

S3 har konfigurerats till att endast fungera med godkänd Apple-utrustning (f.n. iPad mini). S3 kan inte synkroniseras med, eller utföra programfunktioner om den är kopplad till annan utrustning.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

FORTSÄTT >

UNDERHÅLL

Underhåll av S3 får inte utföras av användare eller tredje part. S3 får aldrig öppnas eller plockas isär. Om kåpan spricker eller skadas på något sätt, försök inte komma åt inre komponenter eller strömkretsar. Detta kan orsaka exponering för ström och risk för eldsvåda eller elstöt. För att undvika stötar, dra om möjligt ut kontakten omedelbart och återlämna S3 till Pharmanex® för underhåll.

OBS!
S3-garantin gäller ej om kåpan har manipulerats på något sätt, om undersidan av S3 har avlägsnats eller om där finns spår av försök att avlägsna kåpan på något sätt. Garantin upphör inte bara att gälla, skanneroperatören hålls dessutom fullt skadeskyldig för S3.

FORTSÄTT >

HANTERING
ELVARNING
ALLMÄNNA VARNINGAR
UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Omständigheter som kräver underhåll:

Om någon av följande situationer uppstår, koppla om möjligt bort S3 från vägguttag och ring teknisk support på ditt lokalkontor.

- Sladd eller uttag är skadade.
- Vätska har spillts ut över apparaten eller föremål har tappats på eller i apparaten.
- Apparaten är fuktig eller våt från kondensation, regn eller vatten.
- Apparaten fungerar inte trots att instruktionerna följs.
- Apparaten har tappats eller kåpan har skadats.
- Apparaten beter sig annorlunda, den klarar t.ex. inte basfunktionerna.
- S3 Scanner App rekommenderar dig att kontakta teknisk support.

FORTSÄTT >

POSITIONERING
KALIBRERING
ARBETSTEMPERATUR
RESA MED S3

POSITIONERING

Pharmanex® BioPhotonic Scanner (S3) är ett instrument som mäter hudens nivåer av karotenoider. Skannern är inte avsedd att användas i medicinskt syfte. Den är inte en medicinsk utrustning eller ett verktyg för diagnosticering av något slag, den kan inte diagnosticera, behandla, mildra, bota eller förhindra någon sjukdom eller tillstånd, eller påverka strukturen eller funktionen i kroppen.

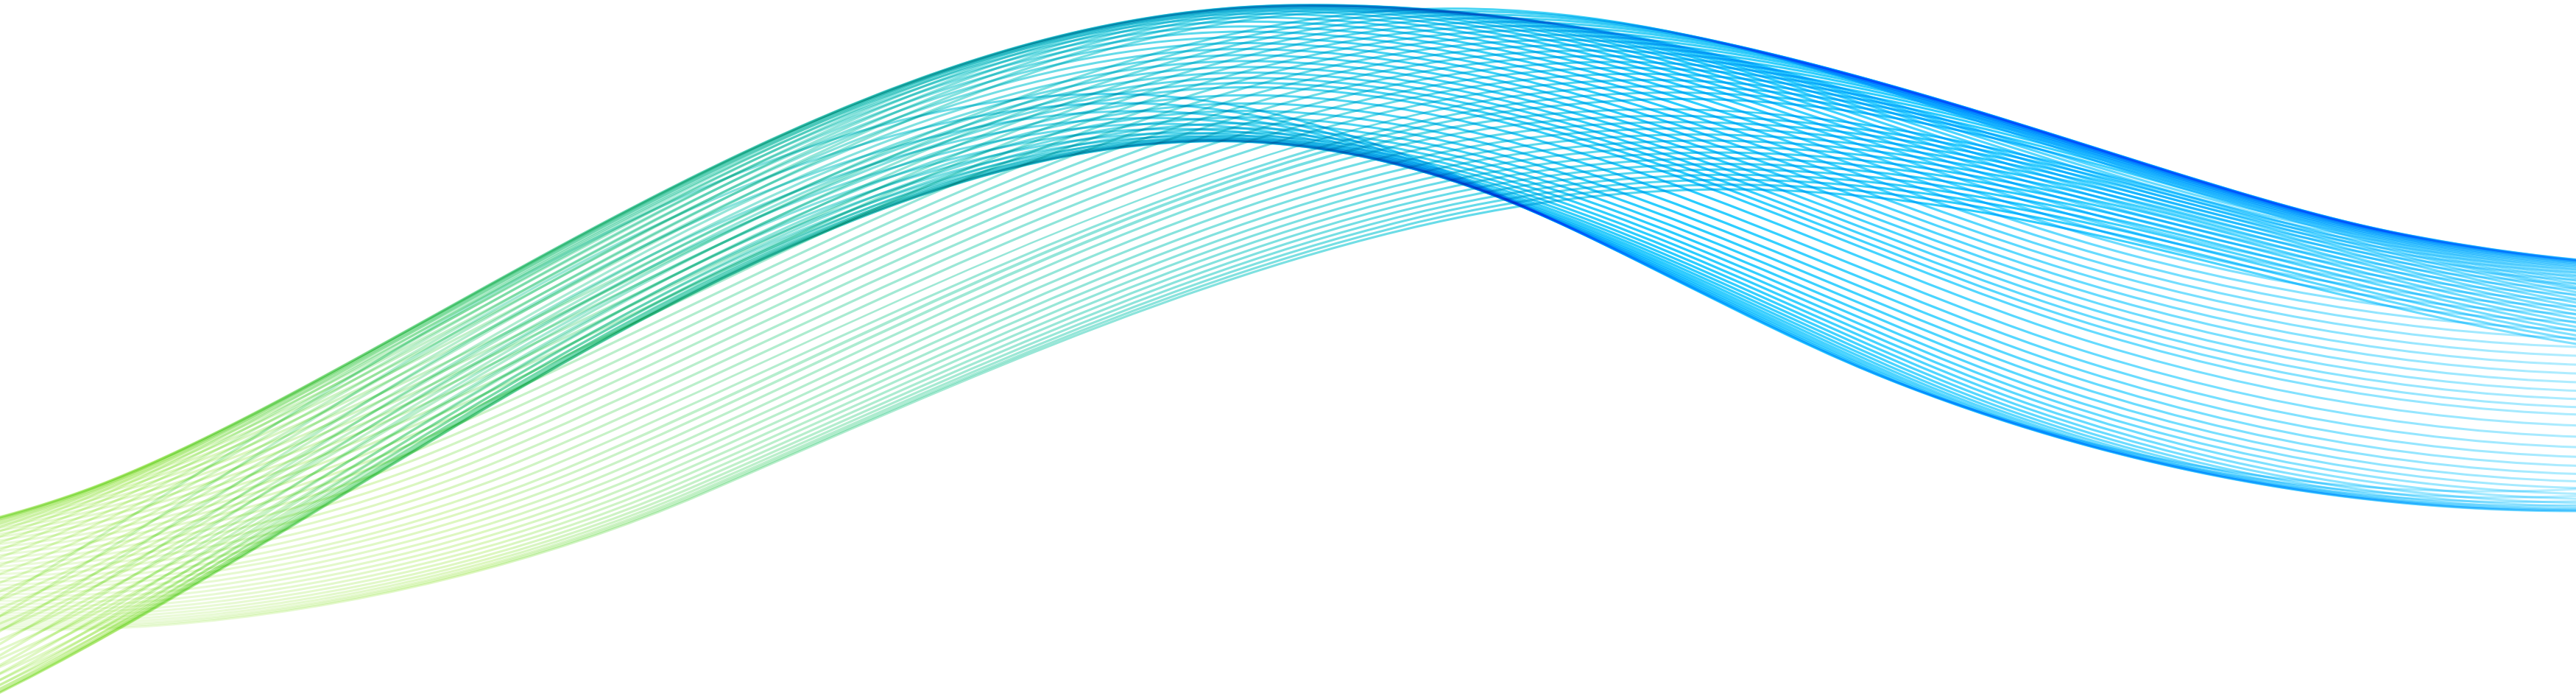

FORTSÄTT >

POSITIONERING
KALIBRERING
ARBETSTEMPERATUR
RESA MED S3

KALIBRERING

Alla precisionsapparater kräver kalibrering. Vissa kalibreras dagligen och andra inför varje mätning. Första gången du använder S3 ska du göra en skanning med locket på och en operatörsskanning. Efter den första kalibreringen behöver du skanna med lock en gång var 24:e timme, och operatörsskanna en gång var 14:e dag.

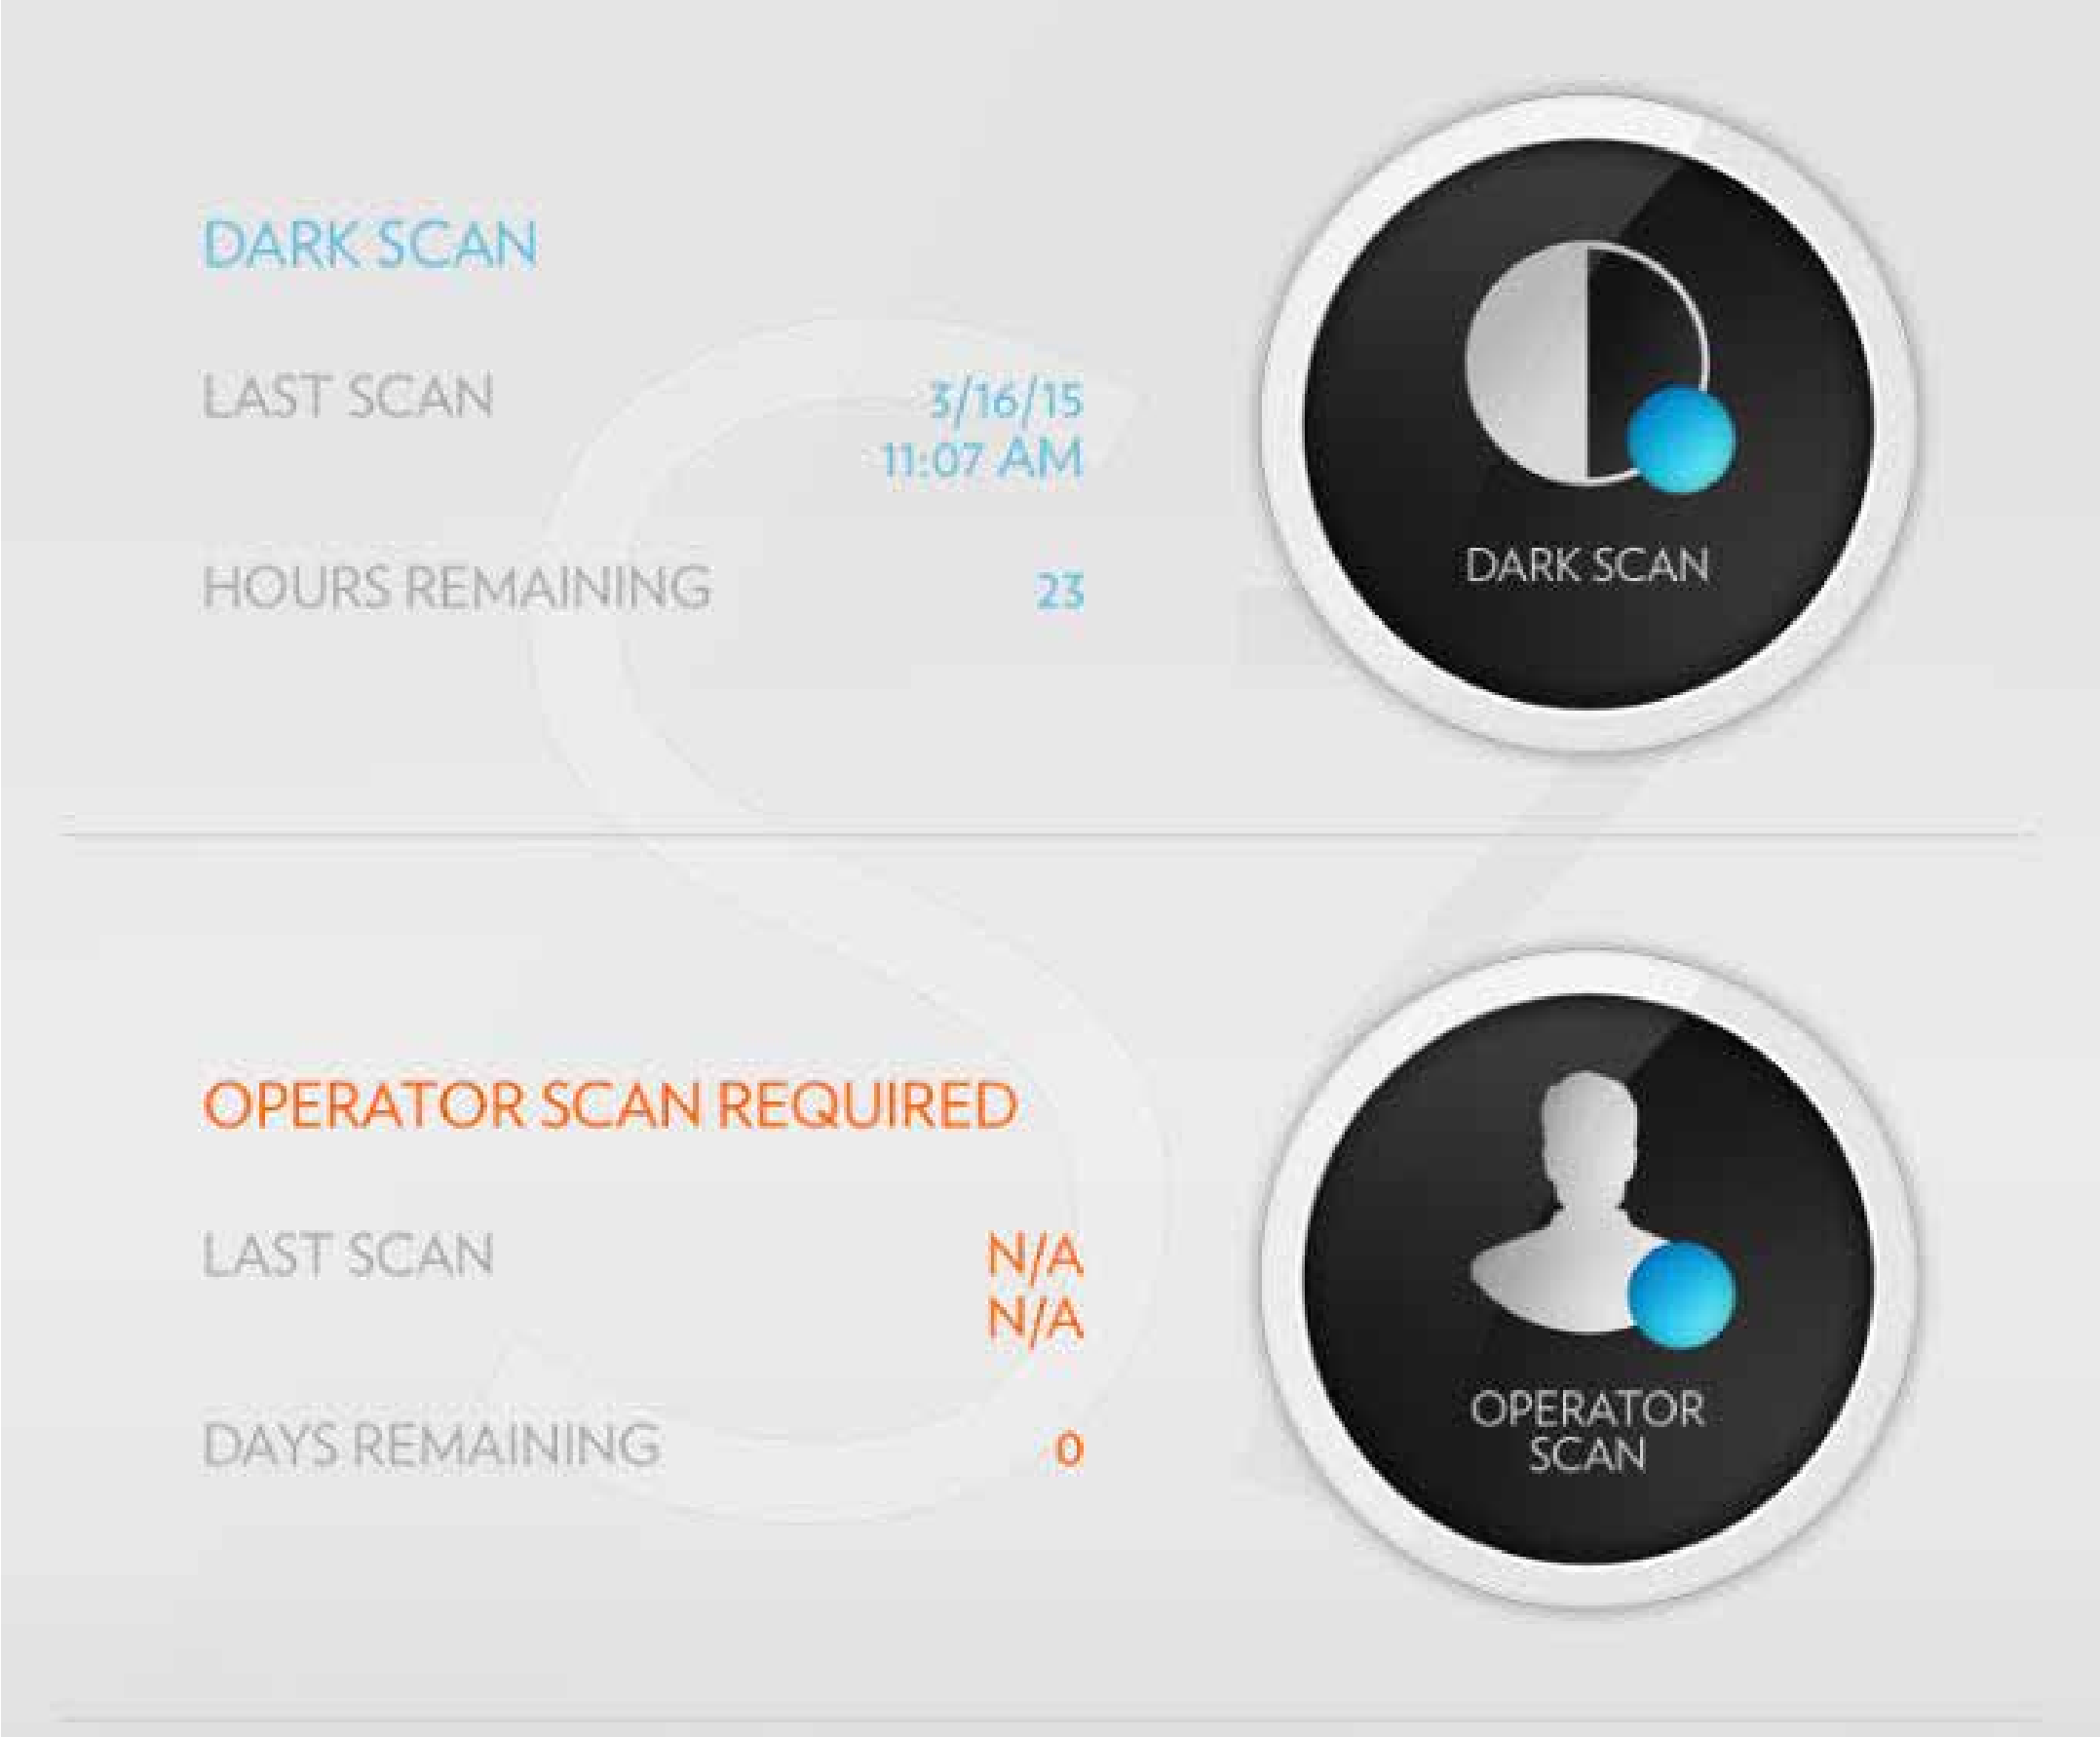

DARK SCAN

LAST SCAN 3/16/15 11:07 AM

HOURS REMAINING 23

OPERATOR SCAN REQUIRED

LAST SCAN N/A N/A

DAYS REMAINING 0

FORTSÄTT >

POSITIONERING
KALIBRERING
ARBETSTEMPERATUR
RESA MED S3

ARBETSTEMPERATUR

S3 kan påverkas av miljön och temperaturen där den förvaras. Den är gjord för att fungera i temperaturer mellan 10° - 40°C. **Optimal skanningstemperatur ligger mellan 20° - 25°C.** S3 bör ej förvaras eller transporteras i temperaturer över 40°C eller under 10°C. Kvarlämning av S3 i bilen en varm dag eller kall natt kan påverka skannerns prestanda.

Dock gäller att om apparaten förvarats i temperaturer som ej omfattas av ovanstående rekommendationer (t.ex. i en bil över natten), måste apparaten anpassas till den miljö där den skall verka innan montering och kalibrering. **Ge S3 erforderlig tid, oftast 30 minuter, att anpassa sig till rumstemperatur innan den kalibreras eller ansluts till eluttag.**

FORTSÄTT >

- POSITIONERING
- KALIBRERING
- ARBETSTEMPERATUR
- RESA MED S3

RESA MED S3

S3 ska endast fraktas i medföljande väska. S3 bör fraktas som handbagage vid flygresor. Detta minskar risken för skador för incheckat bagage, i form av extrema temperaturer, ovarsam hantering etc. Kom ihåg att S3 är ett ytterst känsligt vetenskapligt instrument och alltid ska hanteras som ett sådant.

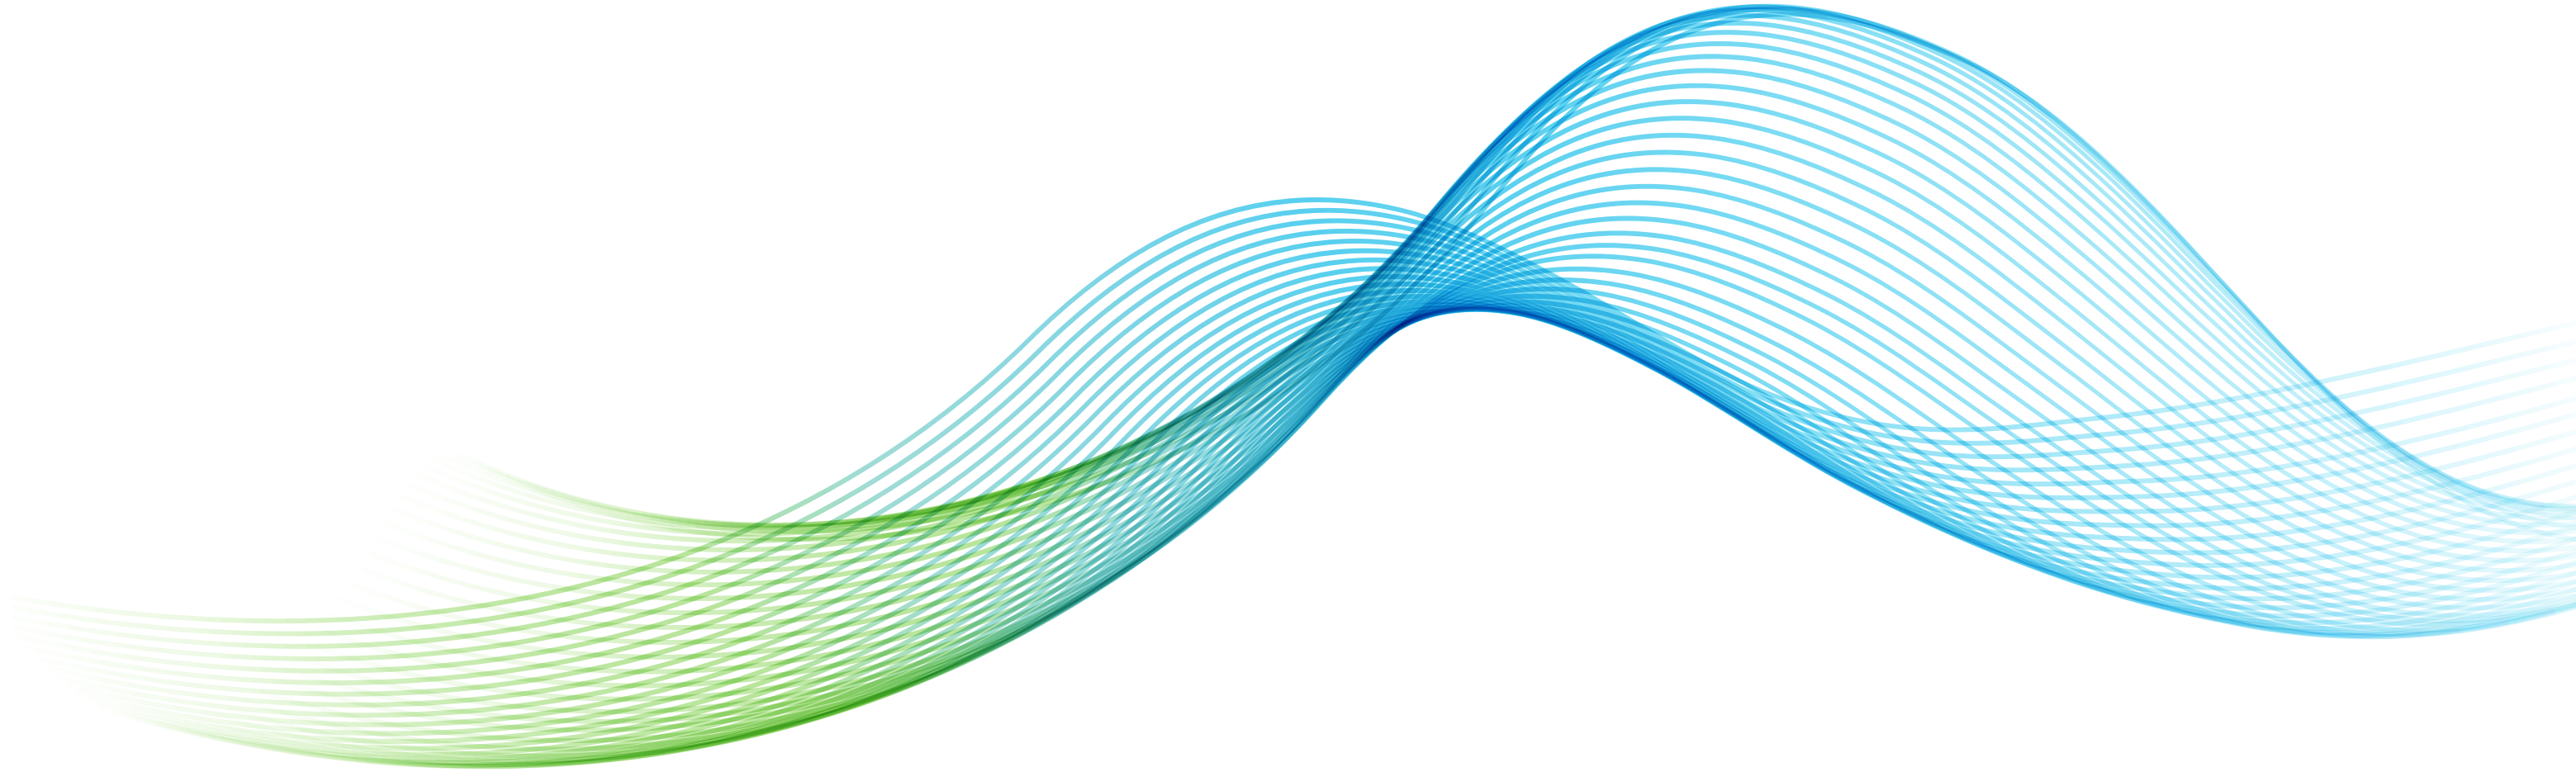

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNING

Försäkra dig om att alla komponenter är inkluderade.

- ✓ S3 Scanner

- ✓ Apple iPad mini* placerat i omslaget

- ✓ Elutrustning & adaptrar

- ✓ Väska till S3 Scanner

- ✓ Lock till S3 Scanner (linsskydd)
(2 totalt, 1 placerat på skannern
och det andra i väskan)

*Medföljer eventuellt inte för din marknad

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

LADDARE

Skannern och iPad mini ska kopplas till jordat uttag och laddas med hjälp av medföljande elutrustning i minst 8 timmar innan den första användningen.

HUR MAN GÖR:

- Anslut sladden till skannerns baksida och kontakten till ett jordat uttag.

  När S3 laddas lyser ett grönt LED-ljus på baksidan av skannern.

- Anslut USB-kabeln för iPad mini till den elektriska USB-adpatern.
- Anslut ena änden av nätsladden till toppen av iPad mini och den andra änden till ett eluttag.

När både S3 och iPad mini är laddade kan du koppla bort dem från eluttagen.

FORTSÄTT >

- KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
- LADDNINGSUTRUSTNING
- AKTIVERING AV IPAD MINI
- ANSLUTA IPAD
- INSTALLERA S3-APPEN
- ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

AKTIVERA IPAD MINI

Tryck på power-knappen överst till höger. Låt fingret glida till höger över skärmen för att komma till hemsidan.

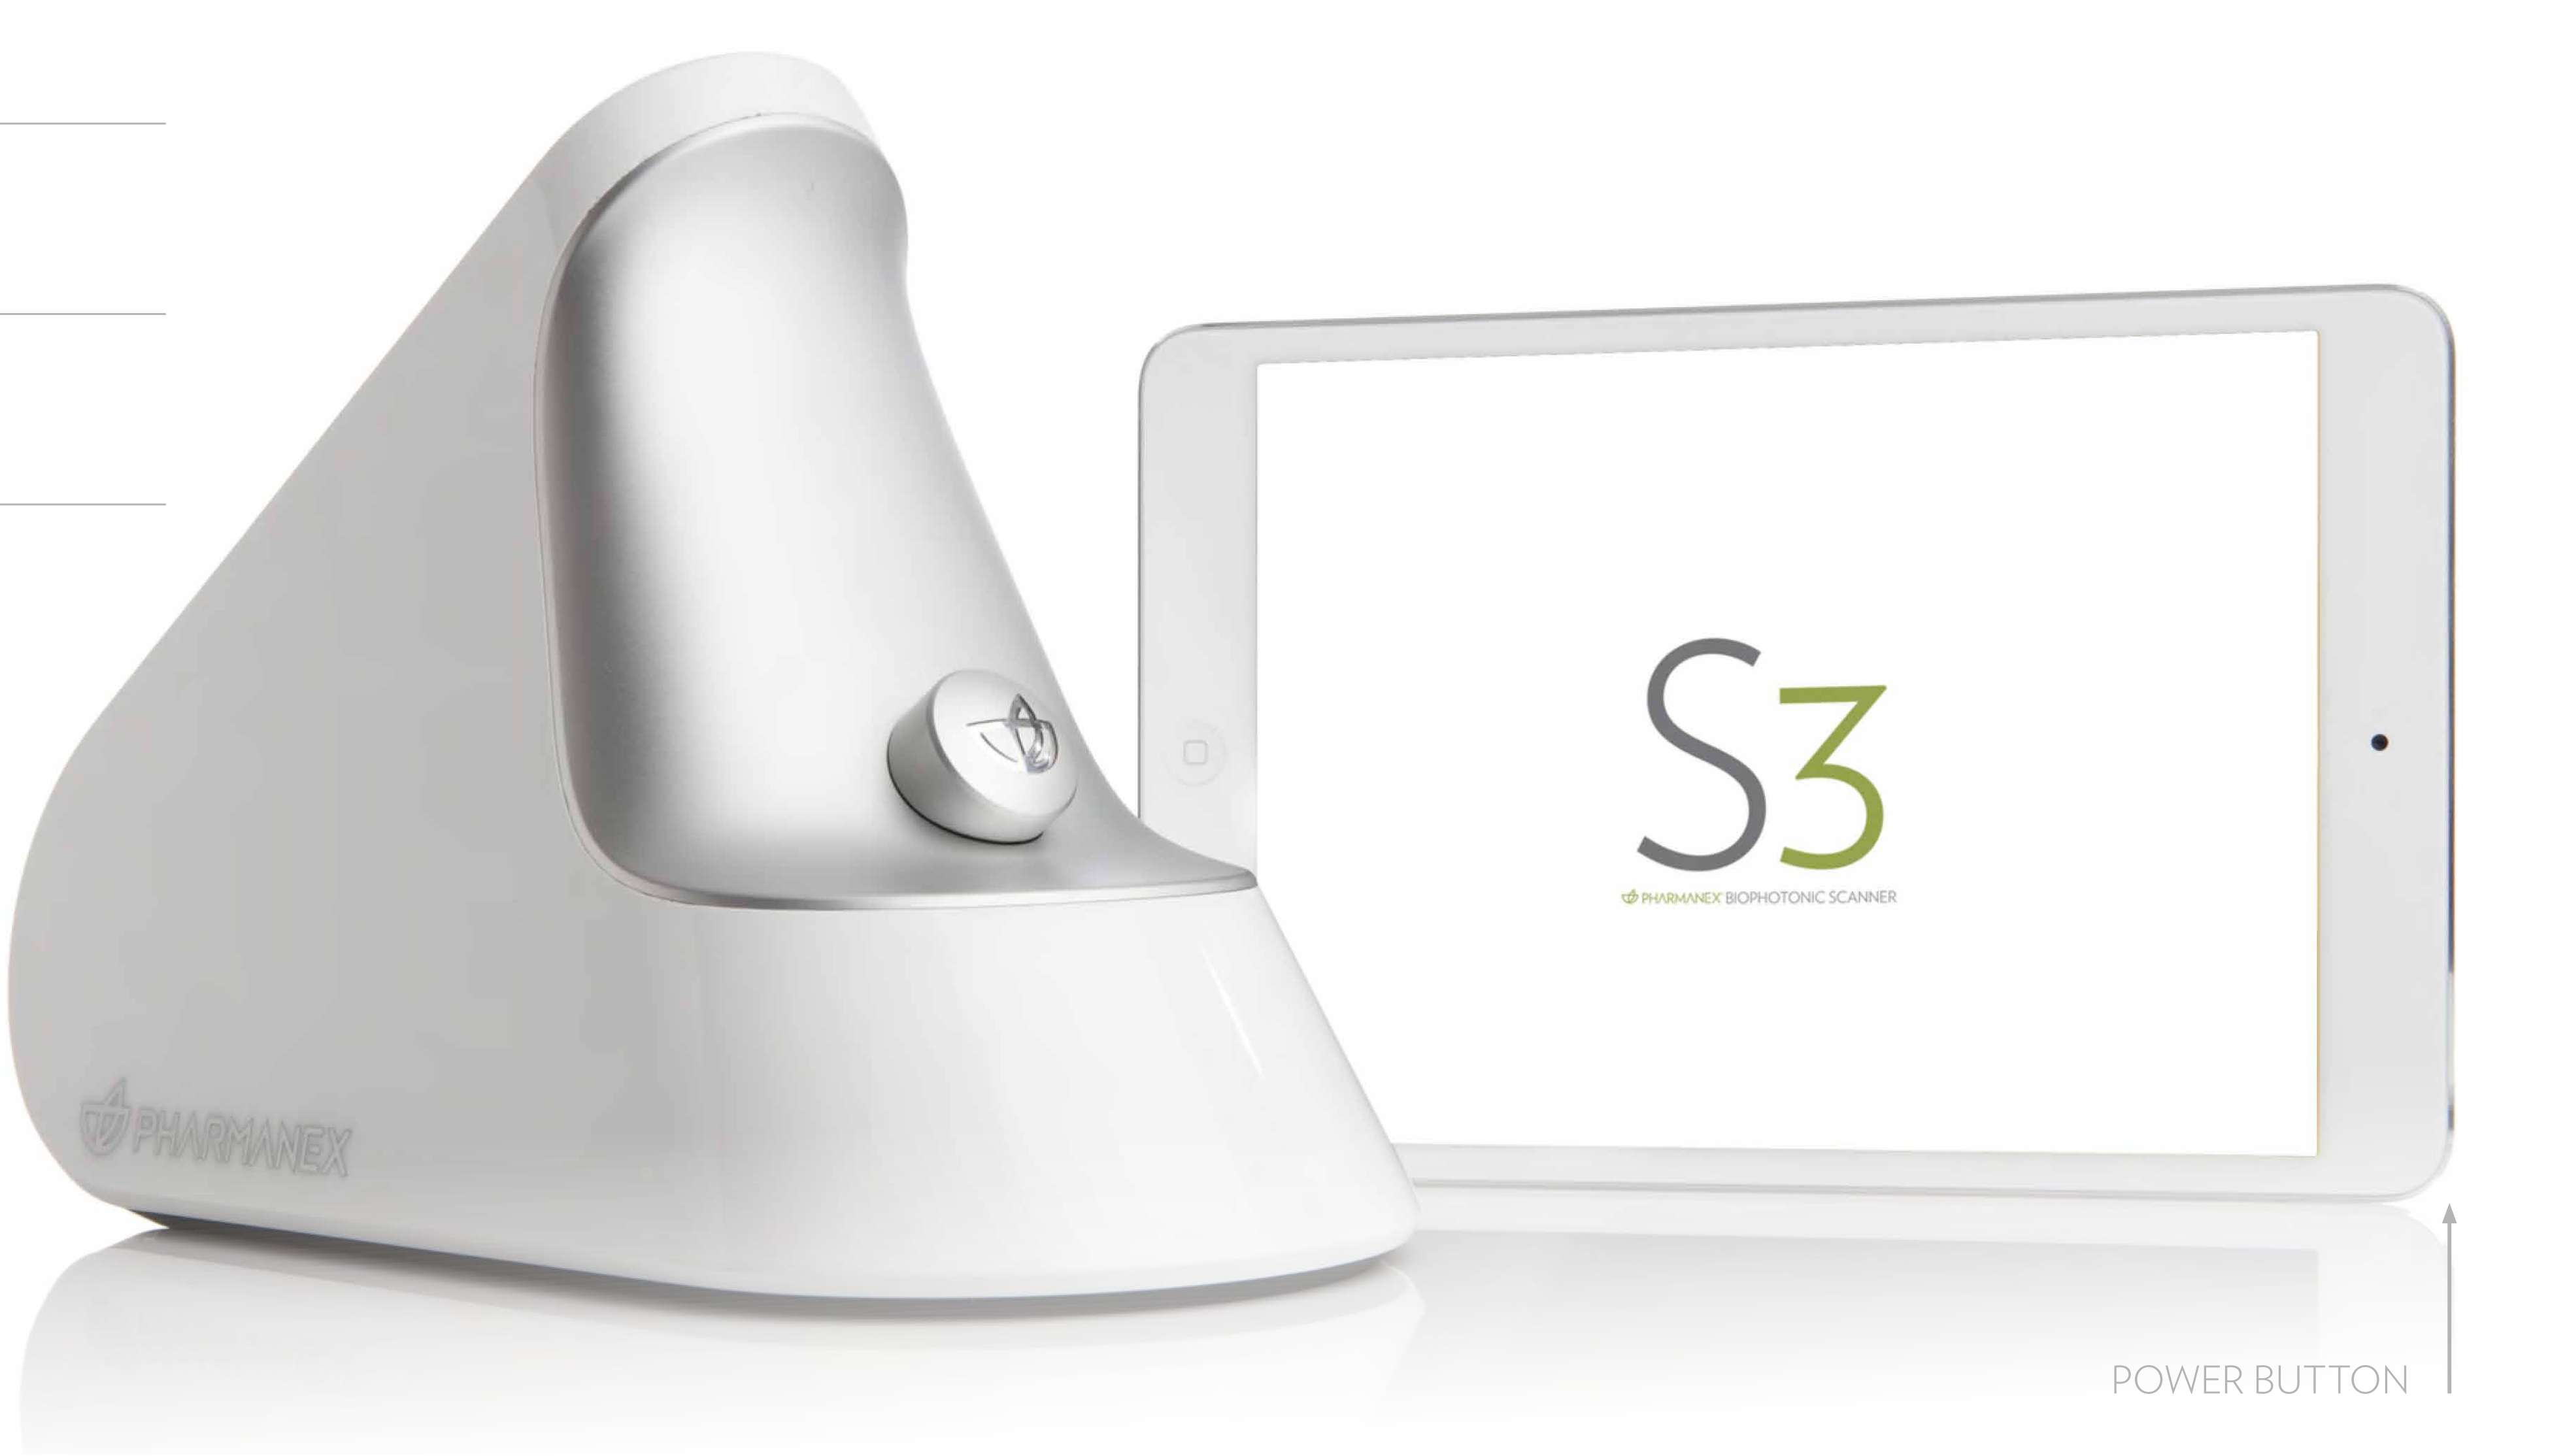
PHARMANEX
S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER
POWER BUTTON

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

ANSLUT IPAD MINI TILL ETT TRÅDLÖST NÄTVERK

Wi-Fi behövs för att:

- Nå internet
- Installera S3 Scanner App. S3 Scanner App måste installeras på iPad mini för att man ska kunna använda skannern
- Synkronisera dina skanningar med Nu Skins server
- Köpa digitala skanningskrediter
- Mejla skanningsresultaten till klienterna

Nu Skin Enterprises tillhandahåller inte trådlösa nätverk och ger heller ingen support för privata eller allmänna Wi-Fi nätverk. Du måste koppla dig till eget trådlöst nätverk eller ett allmänt dito och se till att detta är säkert.

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

ANSLUTA IPAD MINI TILL WI-FI

- Vid aktivering av iPad mini visas automatiskt startskärmen. Du kan alltid återvända till hemsidan genom att trycka på ”Startskärm” längst ned.
- Startskärmen är fylld av flera små ikoner. När du trycker lätt på skärmen aktiveras datorprogram som kallas ”appar”.
- Finn Inställnings-appen på startskärmen.
- Lokalisera Wi-Fi-alternativen överst till vänster på skärmen. Tryck på Wi-Fi för att konfigurera alternativa trådlösa nätverk.
- Se till att Wi-Fi är påslaget.

FORTSÄTT ›

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

ANSLUT IPAD MINI TILL WI-FI

- En lista på tillgängliga nätverk visas nedanför. Välj det nätverk du vill ansluta till och slå in säkerhetskoden som krävs.

Exempel:

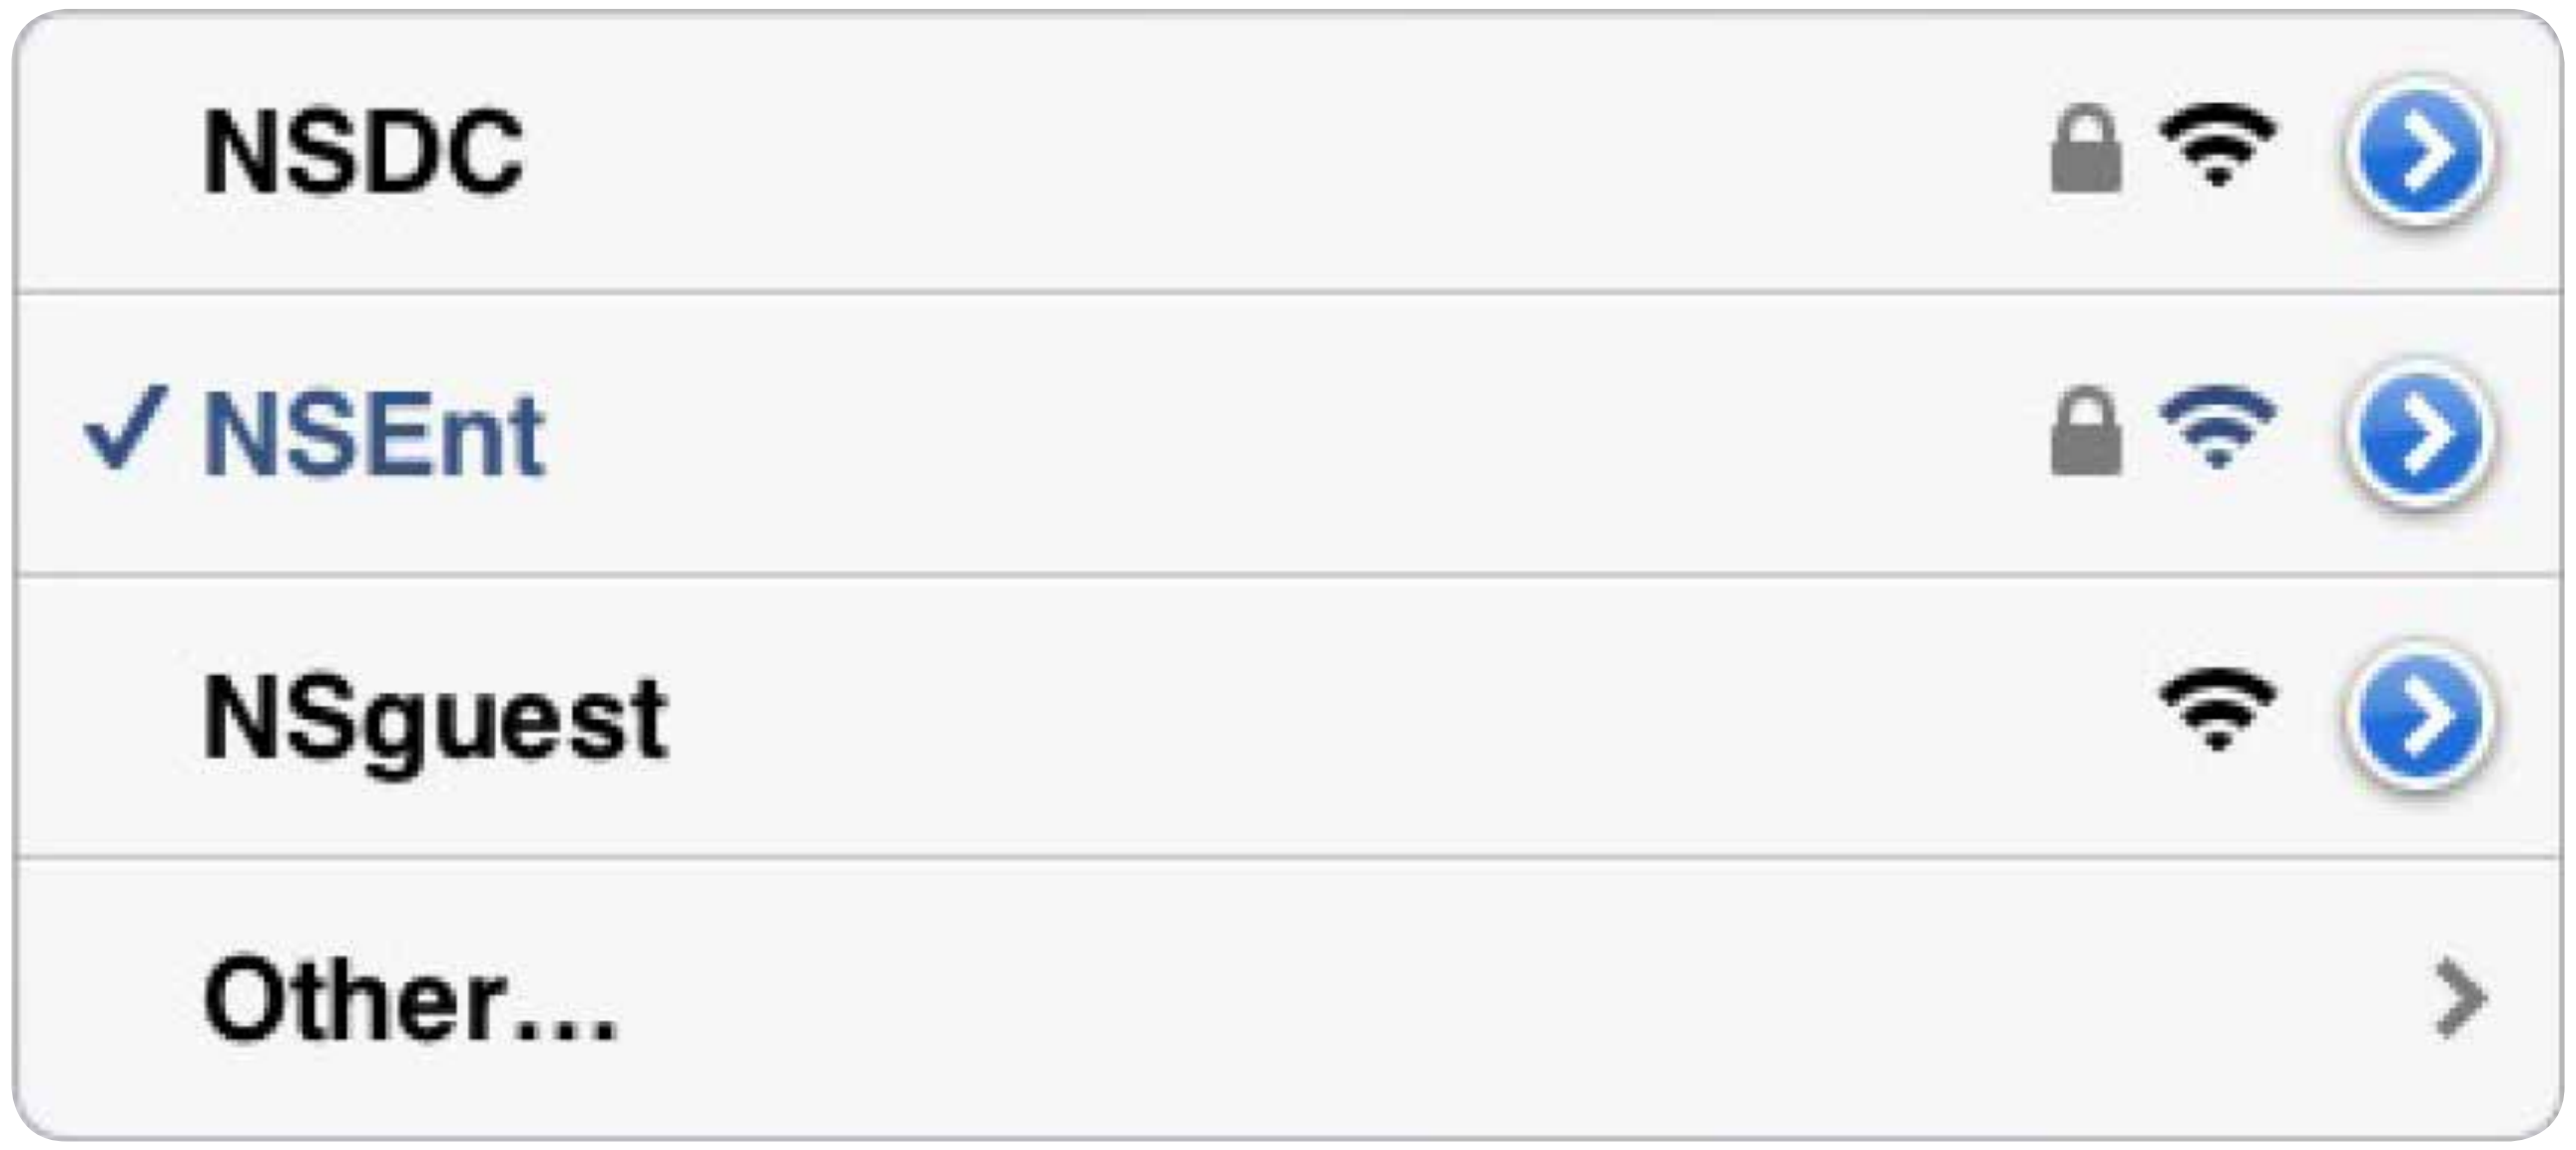

NSDC
✓ NSEnt
NSguest
Other…

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

ANSLUT IPAD MINI TILL WI-FI

- När du valt trådlöst nätverk, kommer iPad mini automatiskt att kopplas till internet via den signalen. En Wi-Fi-ikon visas i övre vänstra hörnet på Apple-utrustningen. Ju flera streck ikonen visar, ju starkare signal.
- iPad mini försöker automatiskt ansluta till det trådlösa nätverk du använt tidigare, så länge du är inom räckhåll för signalen. Ett vanligt räckhåll för Wi-Fi är 36-91 meter. Störningar kan försvaga signalomfånget på Wi-Fi.

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

INSTALLERA S3 SCANNER APP PÅ IPAD MINI

PÅMINNELSE:
Du kommer inte att kunna installera S3 Scanner App på din iPad mini om denna inte är ansluten till Wi-Fi.

Klicka på Safari App på startskärmen. Skriv in webbadressen:
www.s3ScannerApp.com

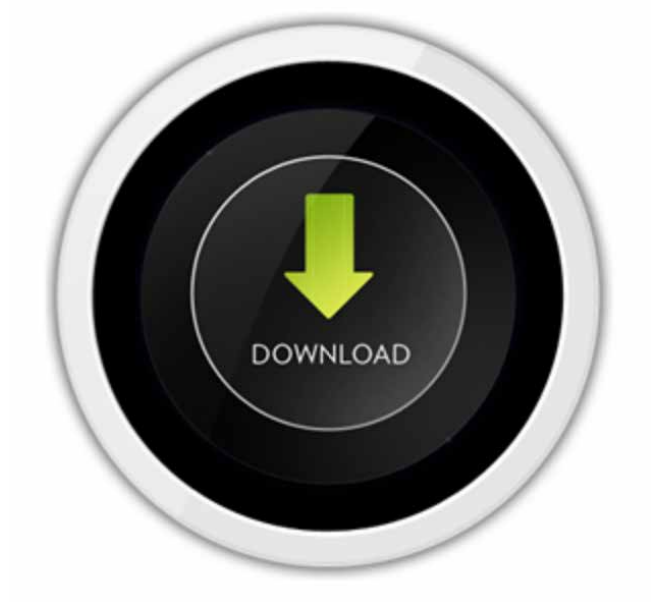

Tryck på “Download/Nedladdning” för att ladda ned S3 Scanner App

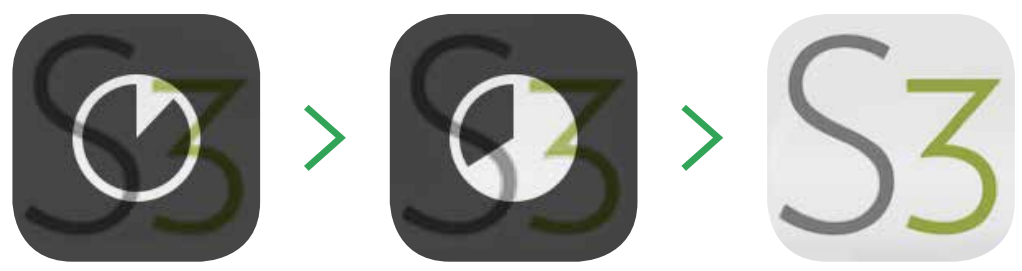

Efter att appen installerats på iPad mini, visas den som ikon på startskärmen.

Tryck på S3 Scanner App-ikonen för att starta programmet.

Du kan när som helst trycka på ”Startskärm/Hem” för att gå ur S3 Scanner App.

FORTSÄTT >

- KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
- LADDNINGSUTRUSTNING
- AKTIVERING AV IPAD MINI
- ANSLUTA IPAD
- INSTALLERA S3-APPEN
- ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

STARTA SKANNERN OCH ANSLUT DEN TILL IPAD MINI VIA BLUETOOTH

PÅMINNELSE:
S3 fungerar med återuppladdningsbara batterier. När batteriet är laddat kan apparaten kopplas från eluttaget och fungera konstant i 6 timmar.

VARNING:
Se till att locket täcker S3-konen innan du slår på skannern. S3 aktiveras inte till fullo om den inte känner av linsskyddet. När locket väl sitter på konen, slå på strömmen till apparaten. Displayen på S3 visar att apparaten är laddad och färdig att anslutas till iPad mini.

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

STARTA SKANNERN OCH ANSLUT DEN TILL IPAD MINI VIA BLUETOOTH

Tryck på ”Hem” för att återvända till startskärmen. Gå in i ”Inställningar” genom att trycka på appen för densamma. Bluetooth ska vara påslagen (”På/On”). iPad mini uppfattar nu Bluetooth-signalerna. Tryck på ”Hem” igen för att återvända till startskärmen.

På baksidan av S3-skannern, till höger om huvudströmbrytaren, finns knappen för Bluetooth. Håll inne Bluetooth-knappen 2-3 sekunder tills den börjar blinka. Det blinkande blå LED-ljuset på baksidan av skannern visar att den nu fått Bluetooth-signal. Nästa gång du slår på skannern, tryck inte på Bluetooth-knappen igen. Det behövs inte längre för anslutningar

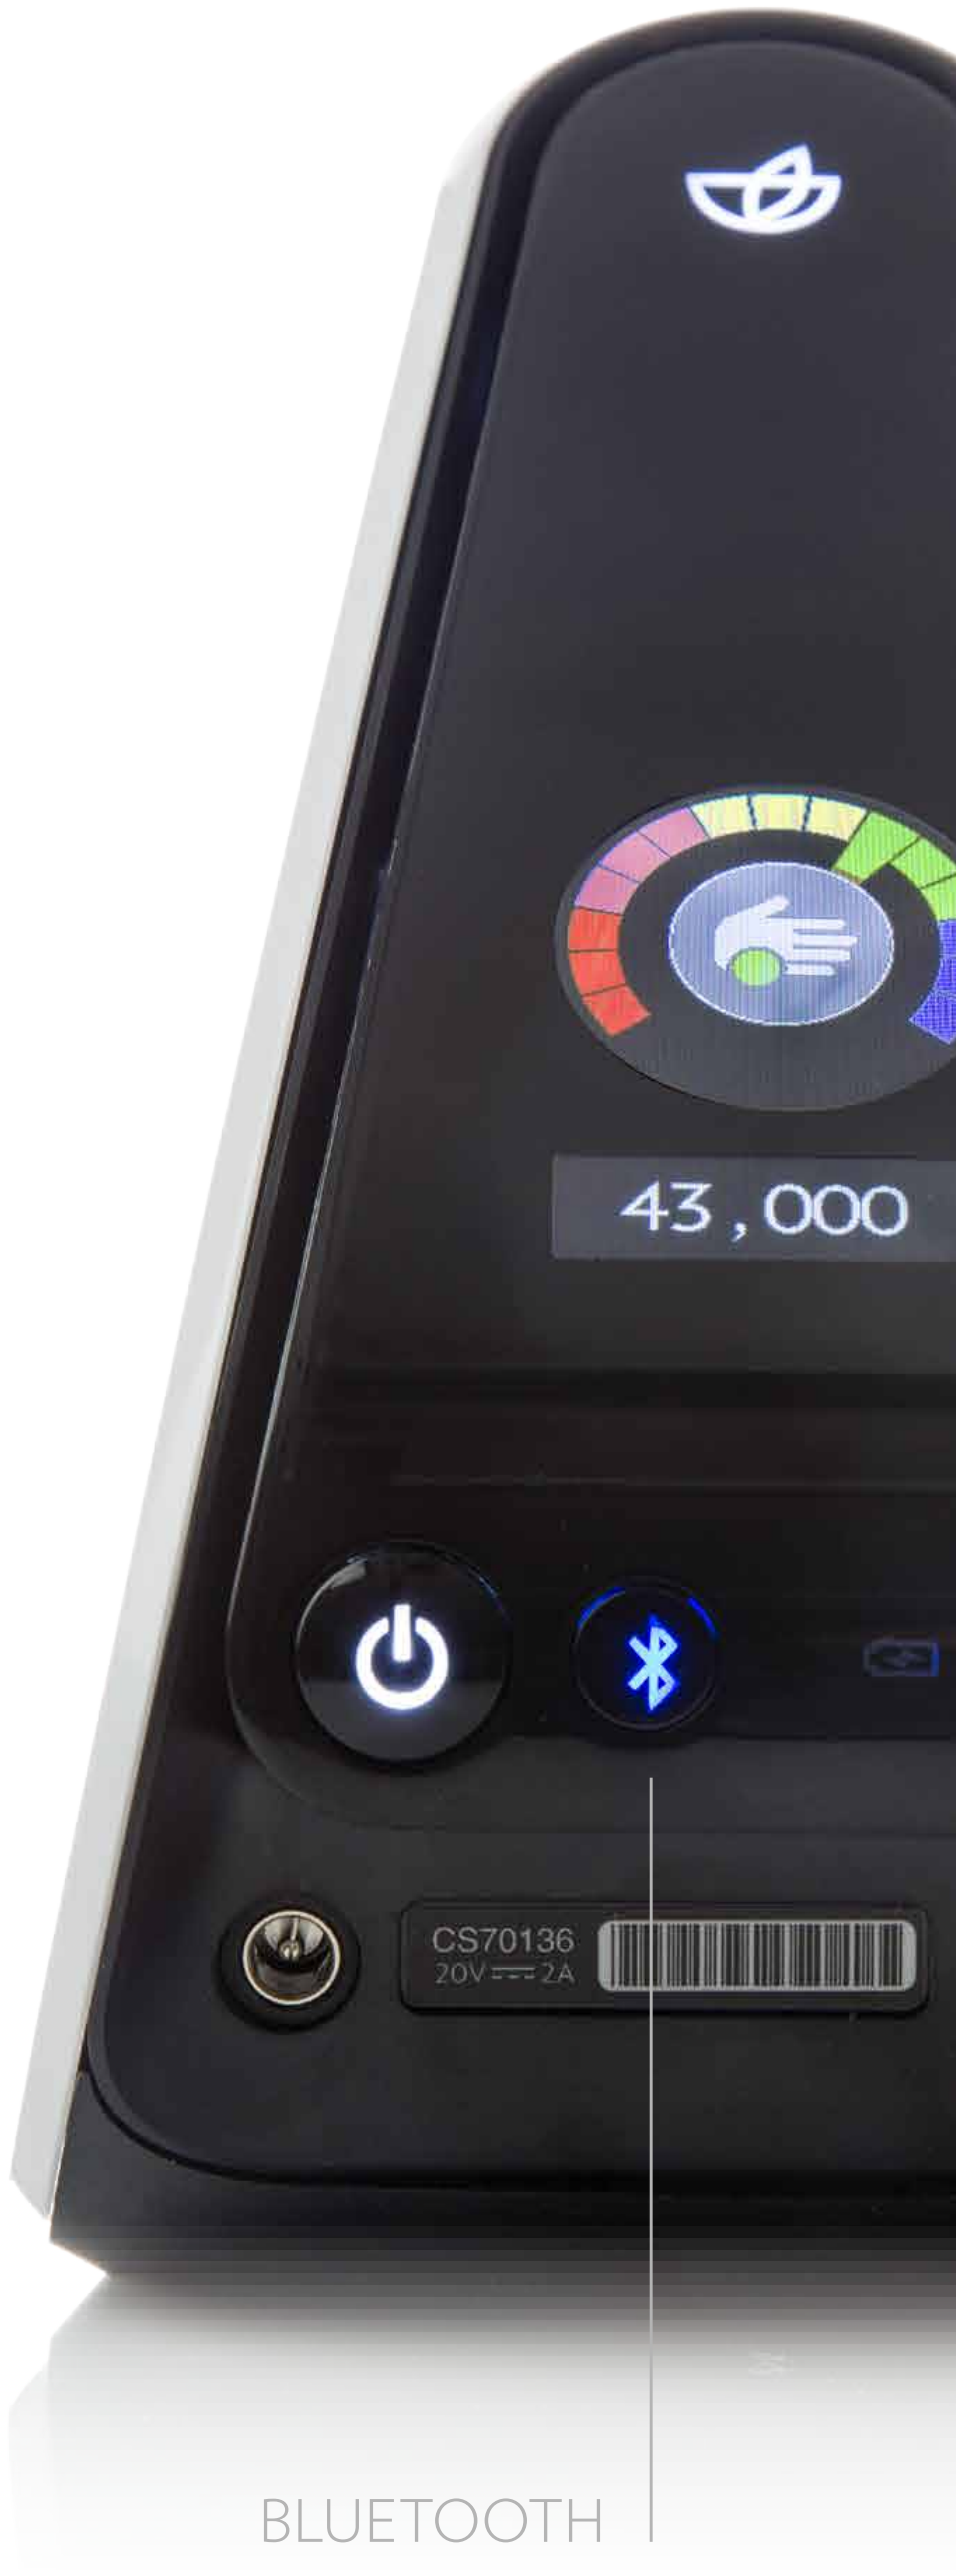

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

STARTA SKANNERN OCH ANSLUT DEN TILL IPAD MINI VIA BLUETOOTH

HUR MAN GÖR:

Tryck på S3 Scanner App. Starta inte S3 Scanner App förrän Bluetooth-knappen blinkar.

› Under fliken “Status”, dra ned pilarna under knappen “Sök efter skanner”.

Nu söker appen efter S3 Bluetooth-signaler. Om din S3 inte finns på listan, dra ned pilarna igen. Ibland kan störningar göra att alla inte upptäcks direkt. Funnen S3-apparatur kan ses till vänster i statusfönstret.

FORTSÄTT ›

- KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
- LADDNINGSUTRUSTNING
- AKTIVERING AV IPAD MINI
- ANSLUTA IPAD
- INSTALLERA S3-APPEN
- ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

STARTA SKANNERN OCH ANSLUT DEN TILL IPAD MINI VIA BLUETOOTH

HUR MAN GÖR:

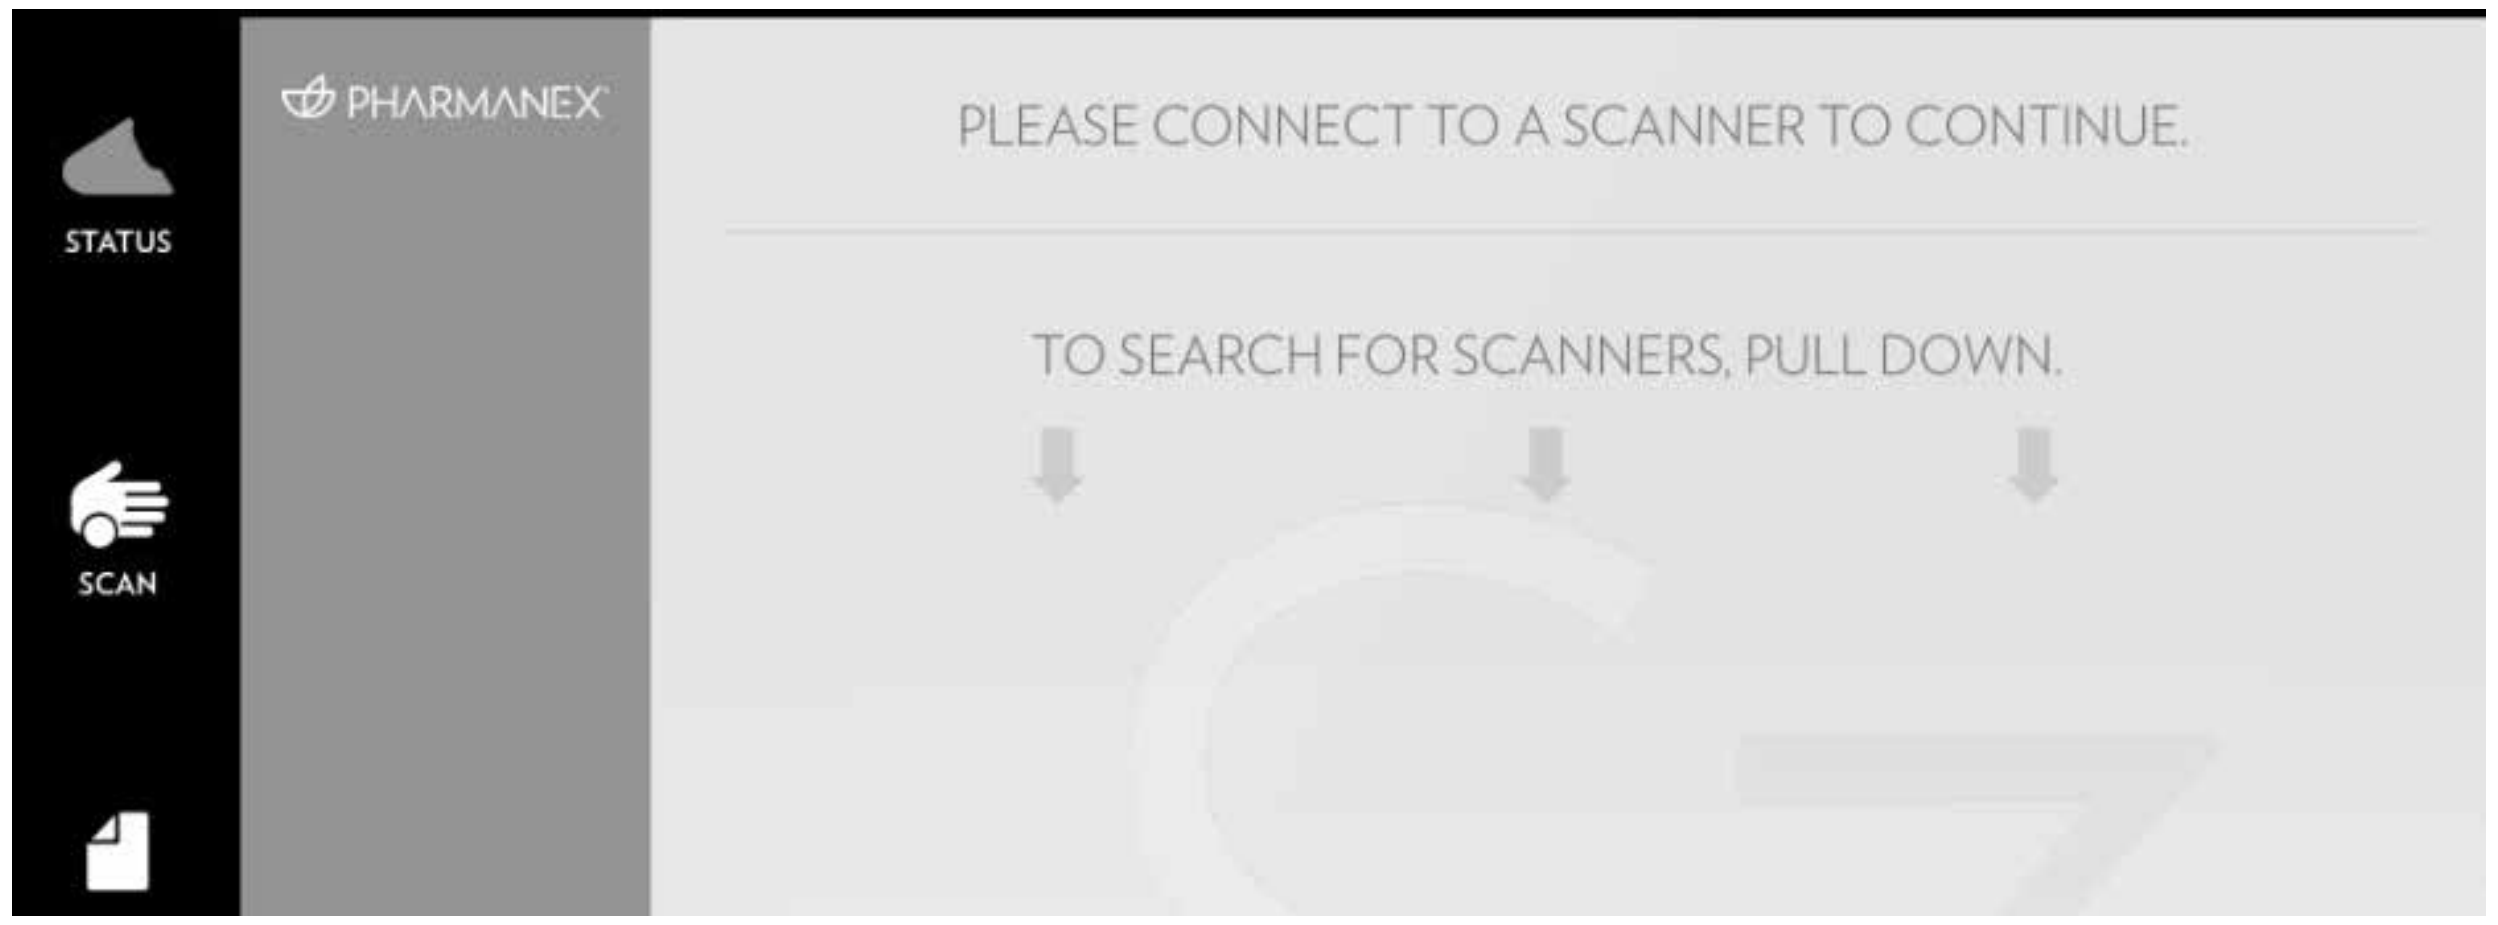

PLEASE CONNECT TO A SCANNER TO CONTINUE.

TO SEARCH FOR SCANNERS, PULL DOWN.

- Klicka på CS-numret för S3.

  Ett fönster frågar om du vill ansluta till skannern.

- Klicka "Ja"

  Anslutning sker.

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN

LADDNINGSUTRUSTNING

AKTIVERING AV IPAD MINI

ANSLUTA IPAD

INSTALLERA S3-APPEN

ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

STARTA SKANNERN OCH ANSLUT DEN TILL IPAD MINI VIA BLUETOOTH

HUR MAN GÖR:

När en S3:a och iPad mini är ansluta till varandra kommer de automatiskt att kommunicera med varandra så länge de är påslagna, tills du väljer ”Avstängd” i statusfönstret.

VIKTIGT!
Endast en iPad mini åt gången kan länkas till S3:an.

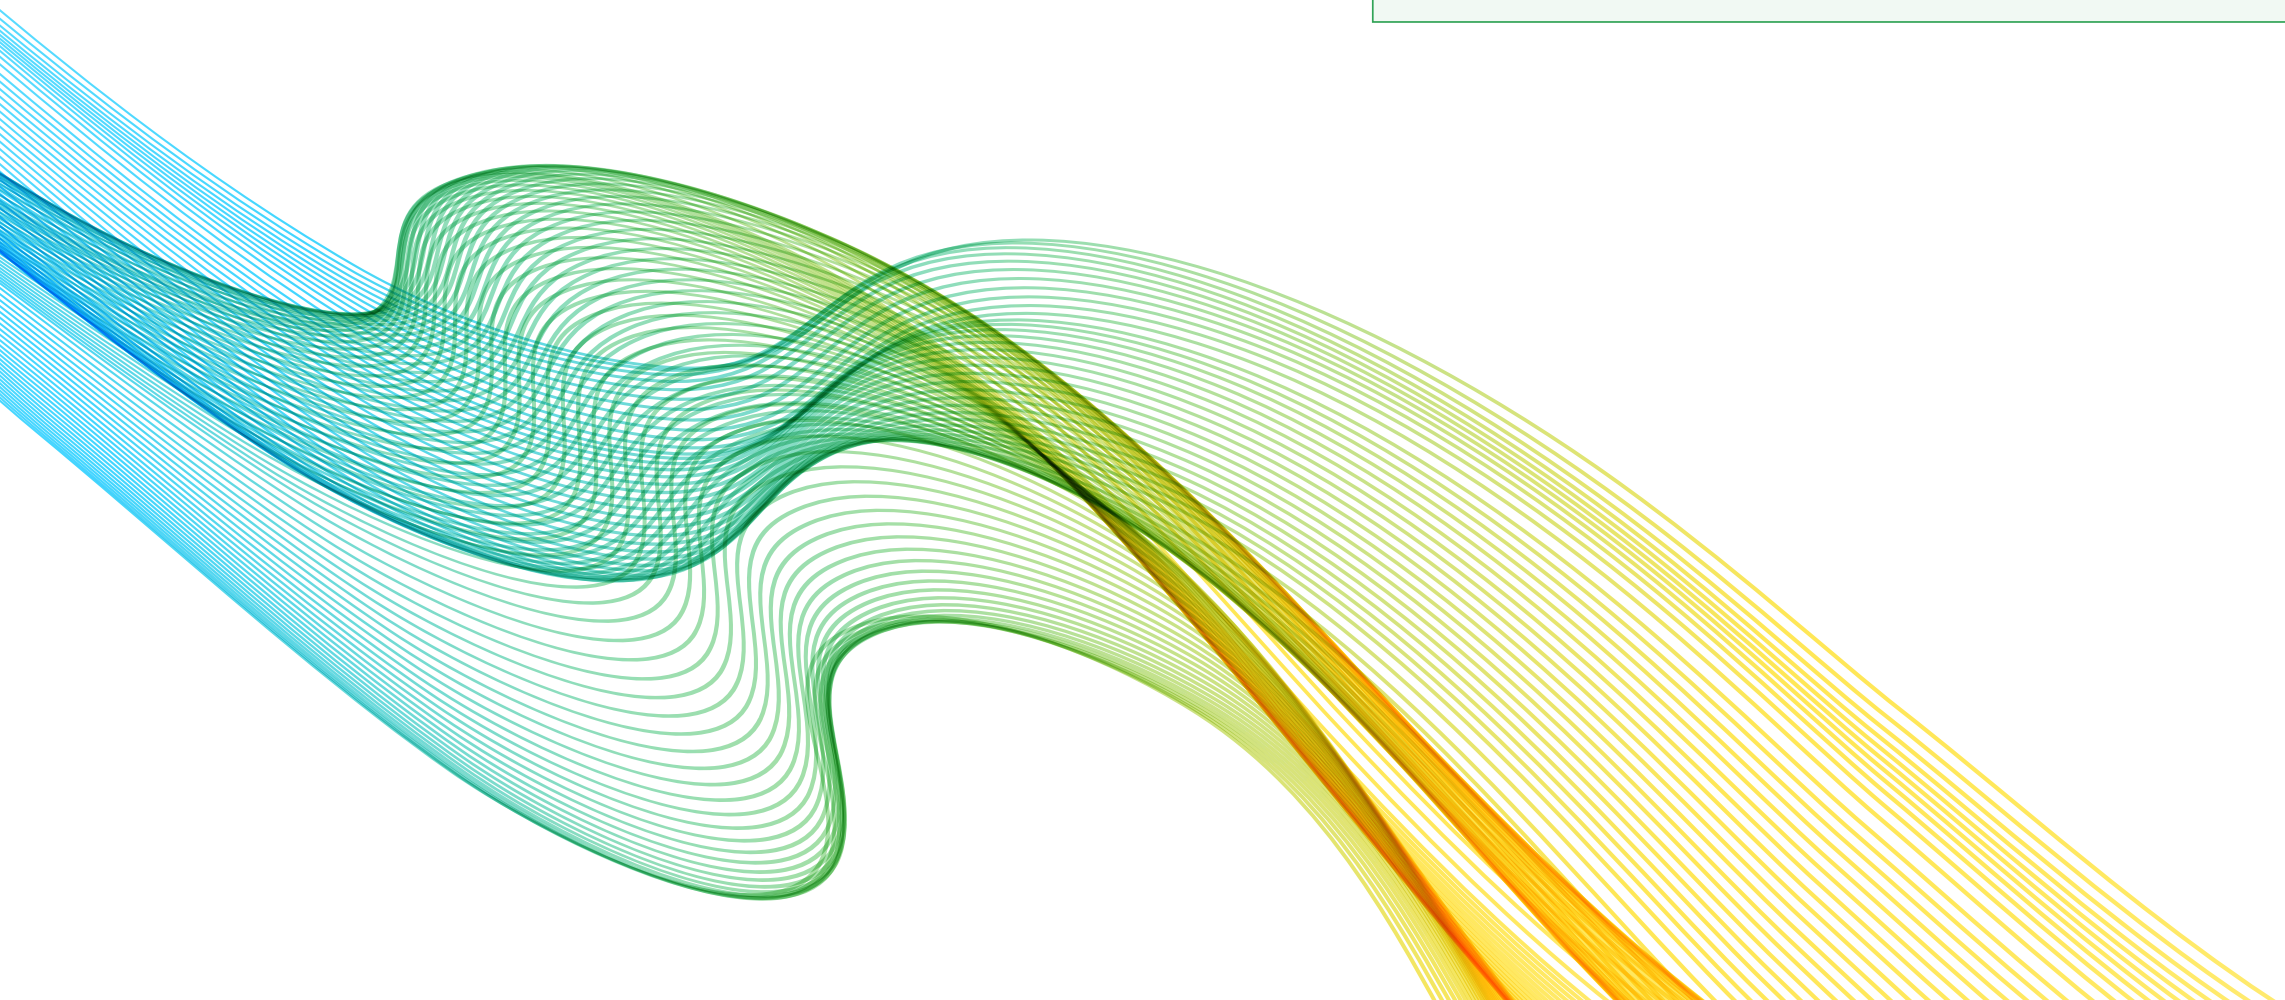

FORTSÄTT >

KONTROLLERA LISTAN ÖVER UTRUSTNINGEN
LADDNINGSUTRUSTNING
AKTIVERING AV IPAD MINI
ANSLUTA IPAD
INSTALLERA S3-APPEN
ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

STARTA SKANNERN OCH ANSLUT DEN TILL IPAD MINI VIA BLUETOOTH

Bluetooth skiljer sig från Wi-Fi. Wi-Fi gör det möjligt för en apparat att ansluta till internet. Bluetooth är den lokala signalen mellan två apparater. Skannern och iPad mini kan kommunicera även om du inte har en Wi-Fi-anslutning, så länge Bluetooth är aktiverad.

Bluetooth-länken mellan enheterna har en maxvidd på ca 50 meter. Störningar från olika källor kan minska omfånget. Statusfliken i S3 Scanner App visar om du är utom räckhåll och bortkopplad från din S3.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

STATUSFLIKEN OCH KALIBRERING AV S3

Status används för att visa skannerstatus och för att kunna kalibrera med lock och vid operatörsskanning. Listan för S3 visar:

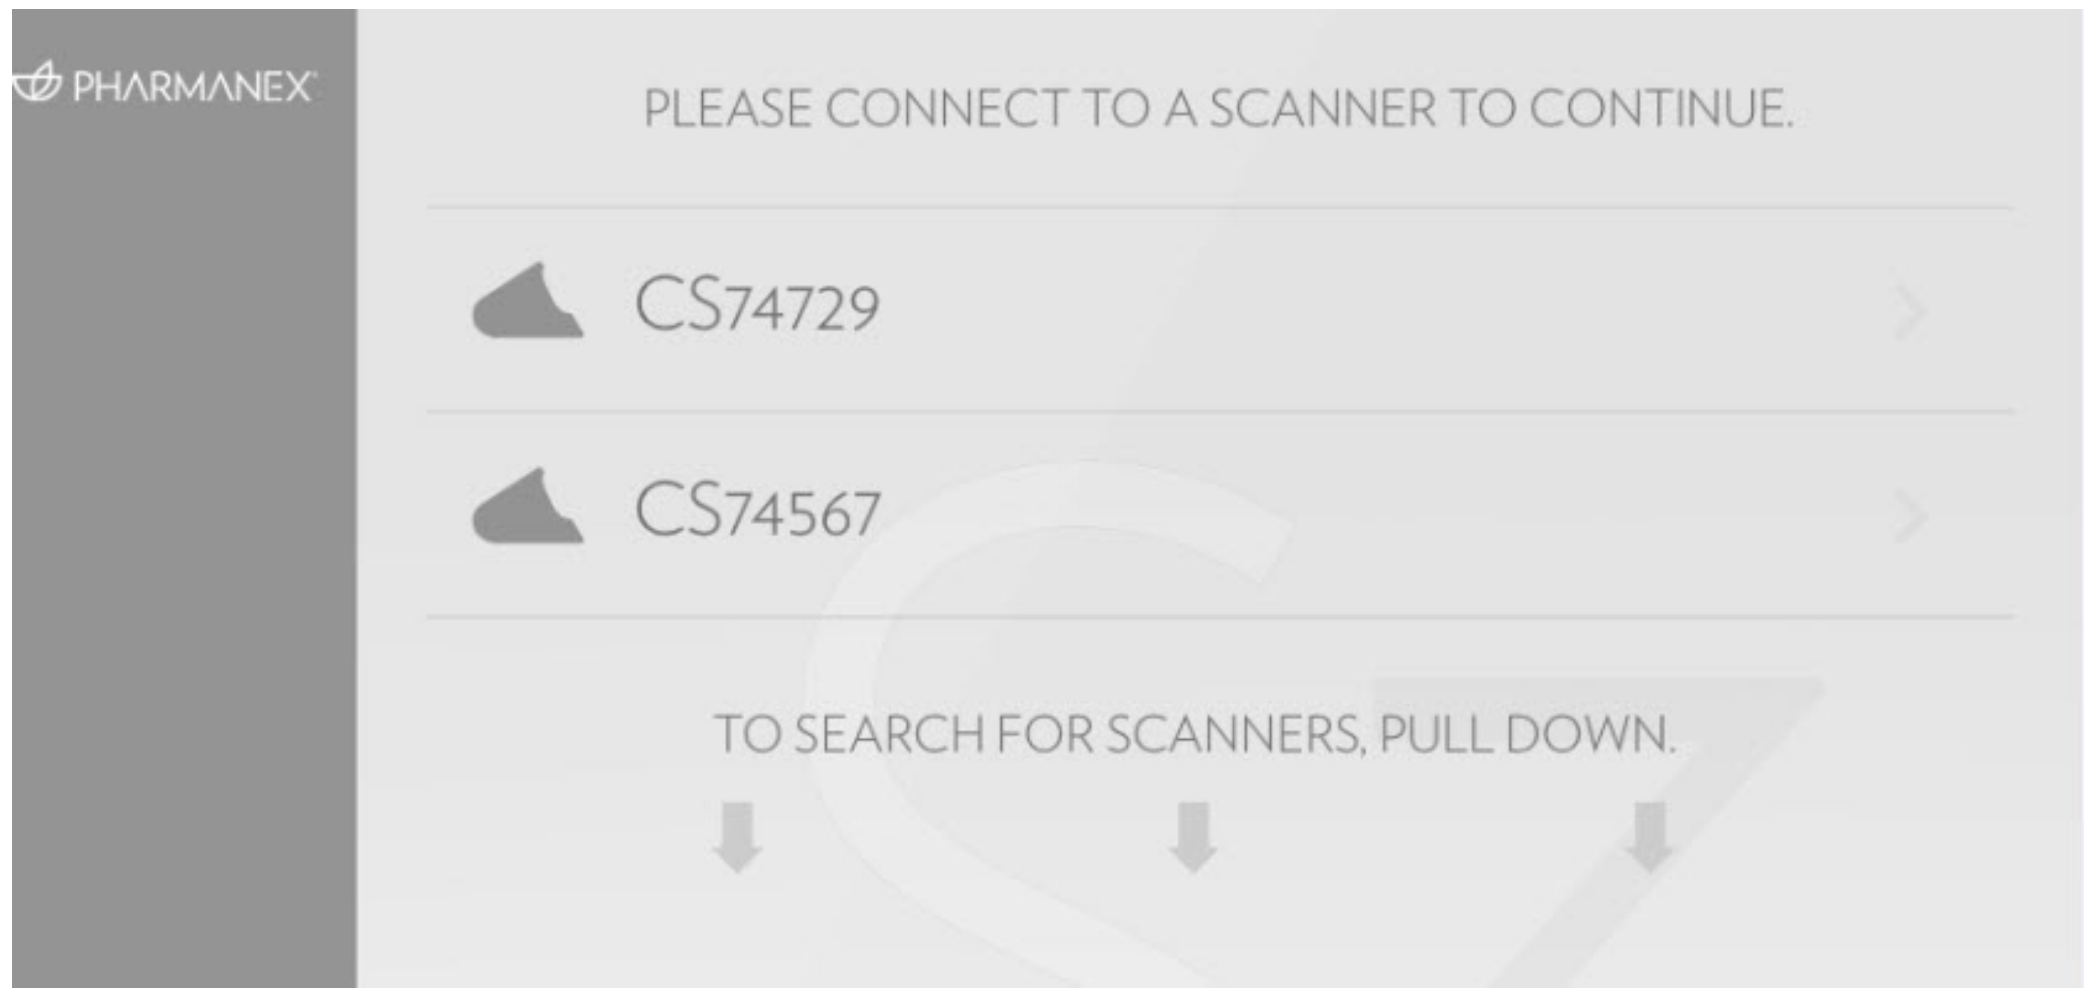

PLEASE CONNECT TO A SCANNER TO CONTINUE.

CS74729

CS74567

TO SEARCH FOR SCANNERS, PULL DOWN.

- Inom räckvidd, grå S3-ikon

OBS!
Om din skanner är ”låst”, kontakta lokal skannersupport.

FORTSÄTT

STATUSFLIKEN

SKANNERFLIKEN

RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

STATUSFLIKEN OCH KALIBRERING AV S3

PÅMINNELSE:
Endast en skanner åt gången kan kopplas till din iPad mini.

När S3 är kopplad till scanner app, visar statusen CS-numret.

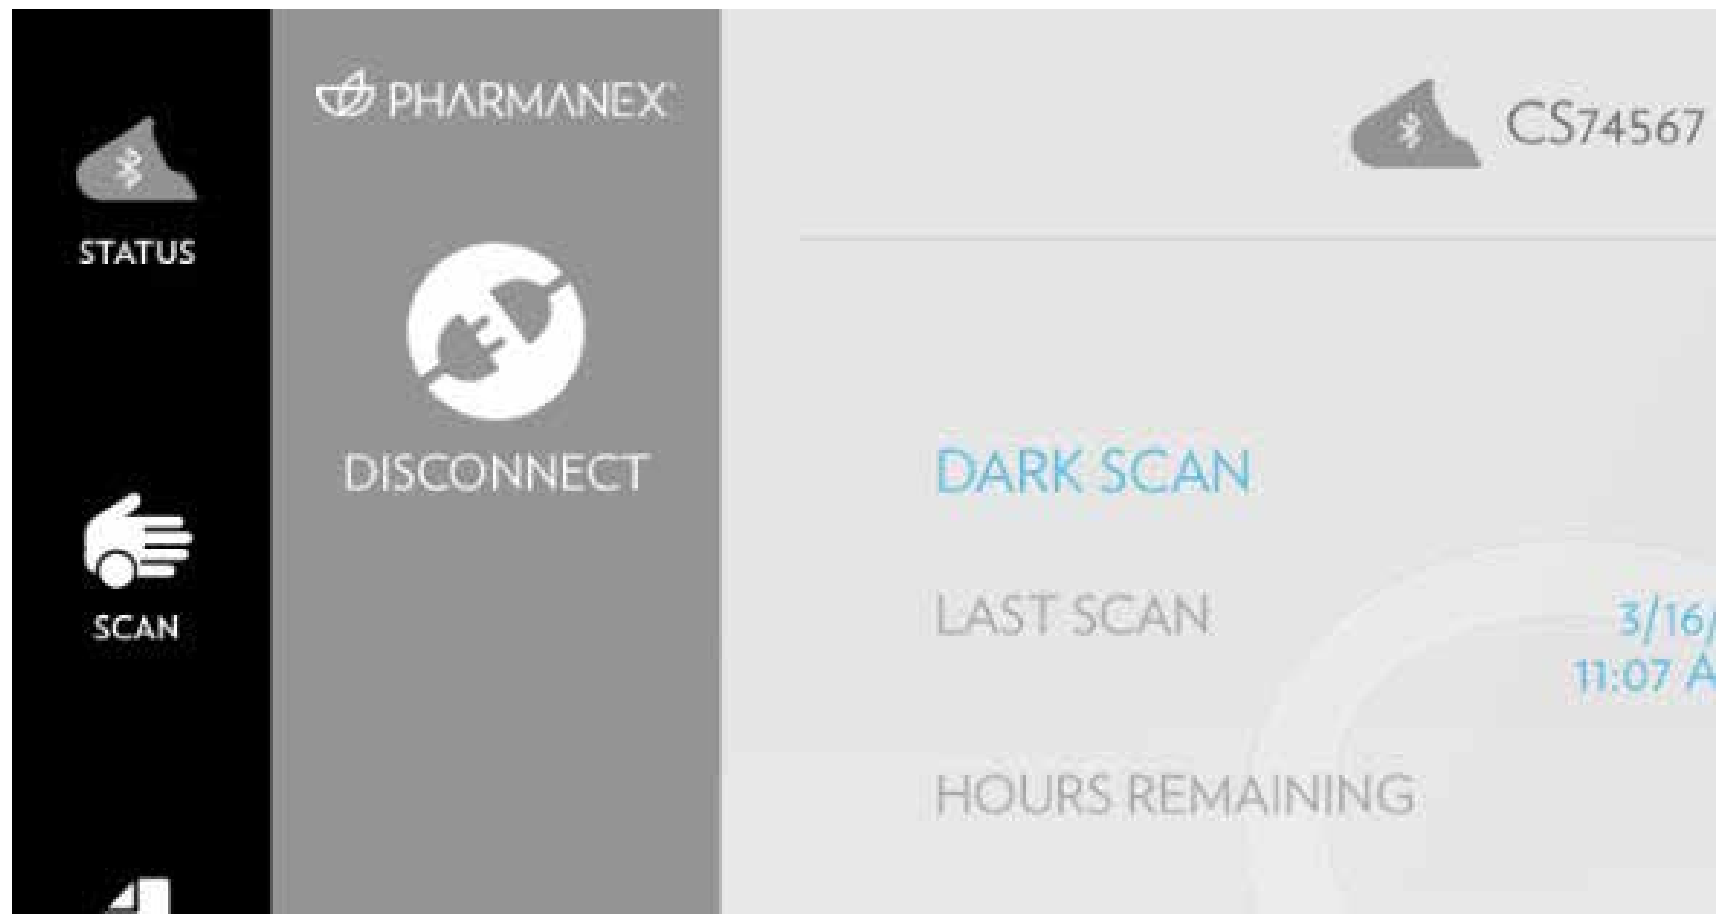
STATUS
SCAN
PHARMANEX
DISCONNECT
CS74567
DARK SCAN
LAST SCAN
3/16/
11:07 A
HOURS REMAINING

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

STATUSFLIKEN OCH KALIBRERING AV S3

Nästa steg: att skanna med lock. Se till att linsskyddet sitter på skannerns kon och tryck på ikonen Skanning med lock. Följ instruktionerna på skärmen tills skanningen är avslutad. Du måste göra en skanning med lock varje dygn.

Ta sedan av locket och gör en operatörsskanning genom att välja ikonen för densamma. En operatörsskanning ska genomföras var 14:e dag.

Dessa kalibreringar används för att spåra konstanten av skanningar. Se till att du utför dessa som du ska.

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

VARNING:
För att skanna någon ska du först ha dennes tillstånd att samla in personuppgifter såsom namn och bostadsort. För att göra detta, ska vederbörande underteckna Bilaga B i ditt S3 skanneravtal. Behåll en kopia av detta. Nu Skin® gör regelbundna stickprov för att se till att du samlar in dessa formulär.

För att kunna skanna någon måste du antingen köpa digitala skanningskrediter eller använda skannerkort.

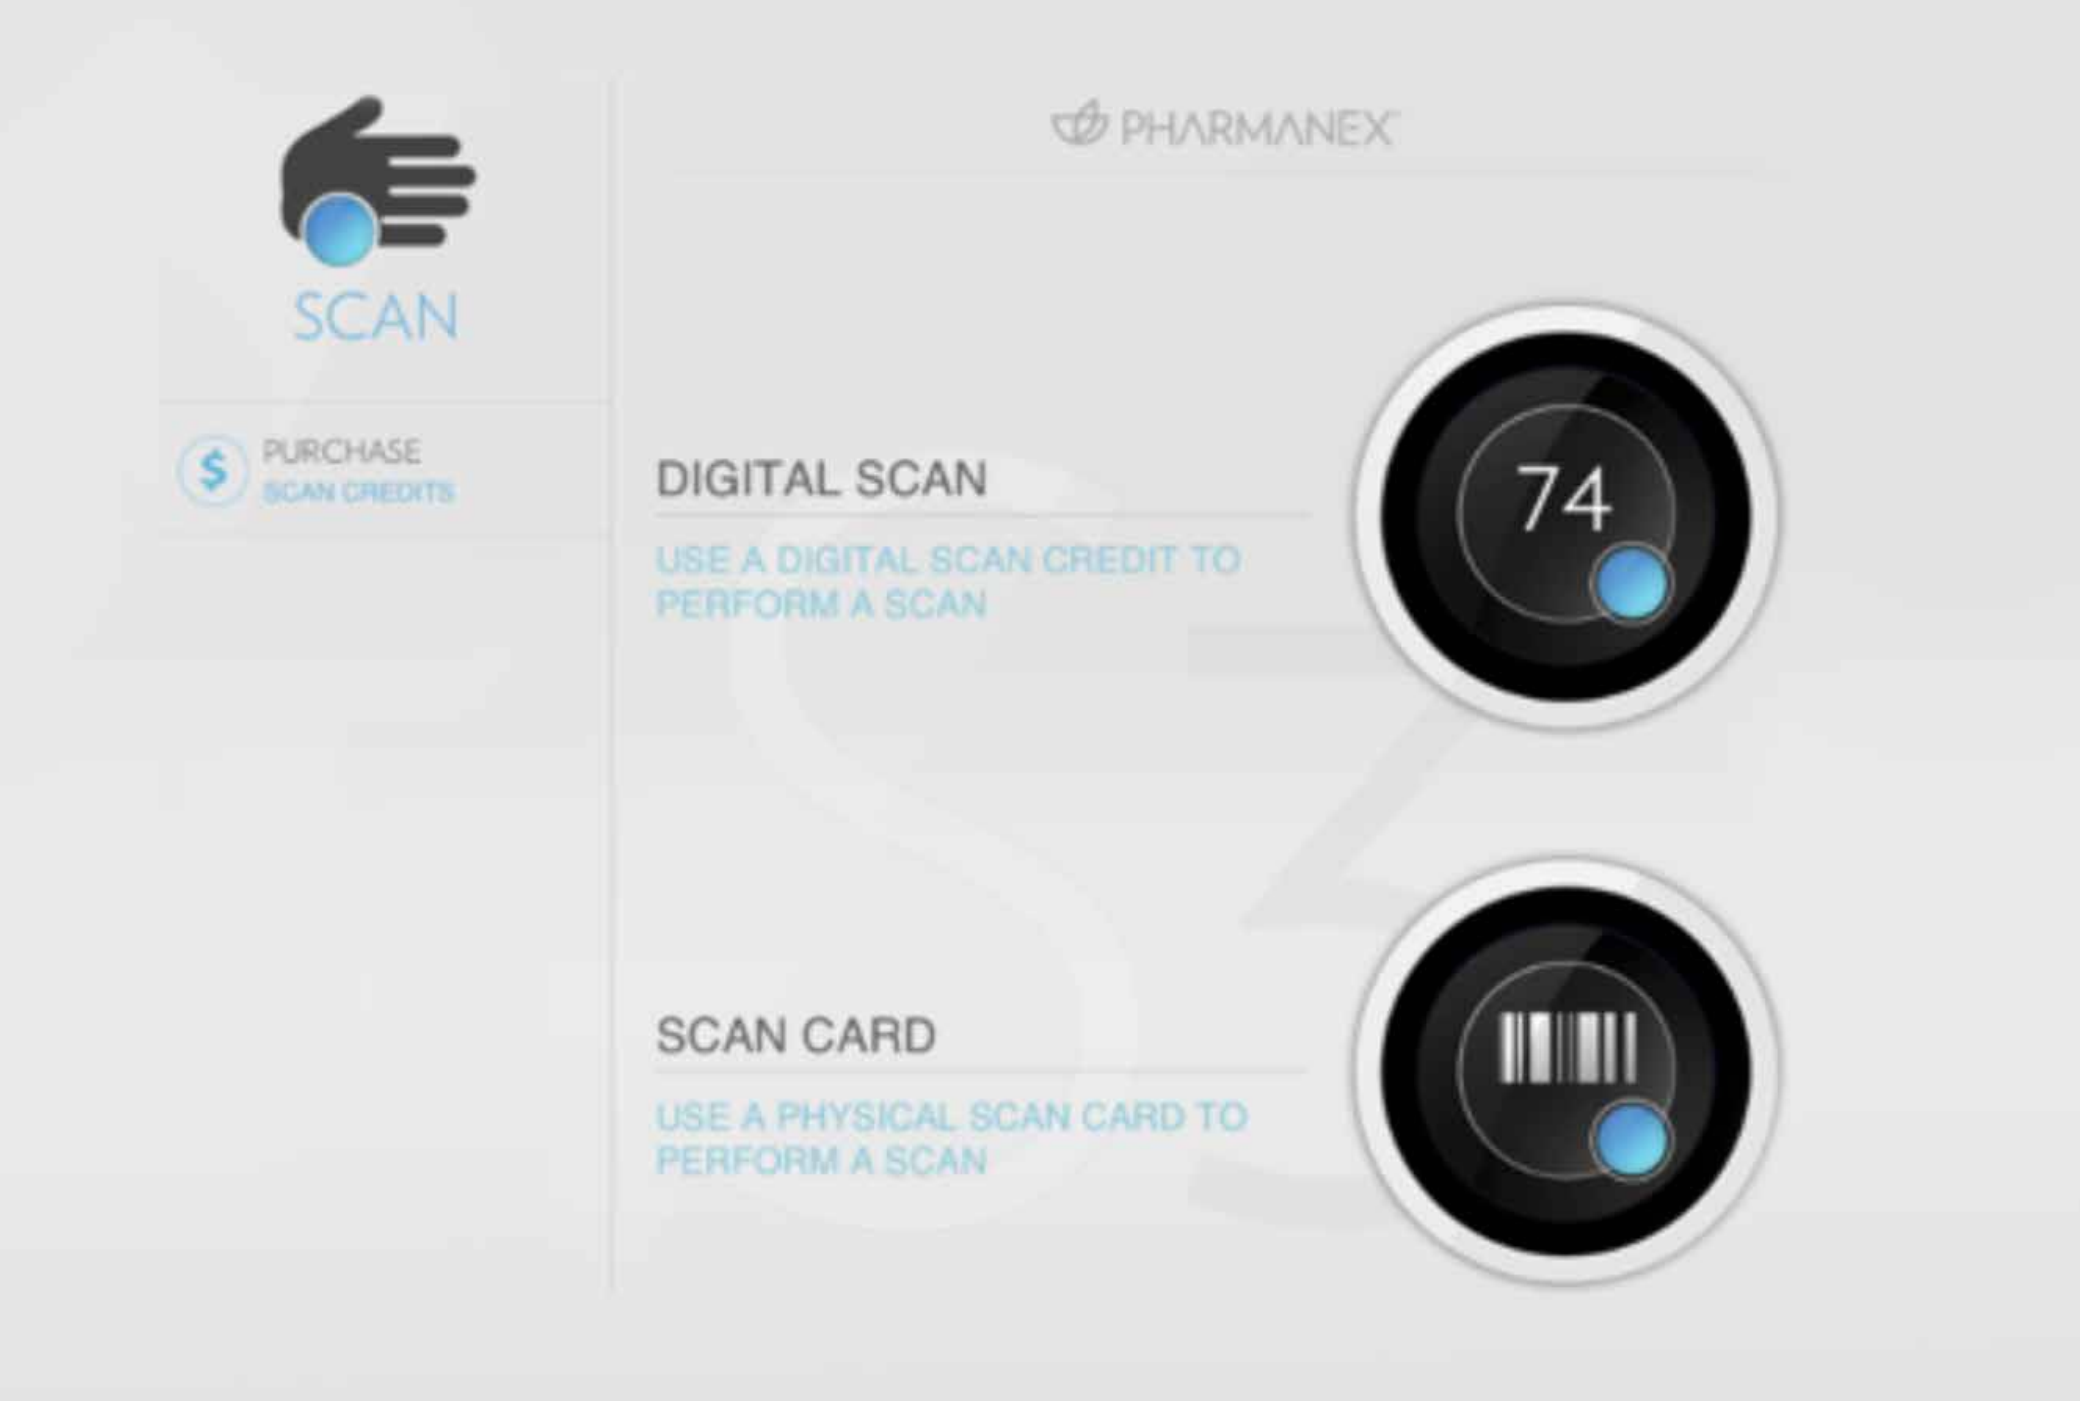
SCAN
$ PURCHASE SCAN CREDITS
PHARMANEX
DIGITAL SCAN
USE A DIGITAL SCAN CREDIT TO PERFORM A SCAN
74
SCAN CARD
USE A PHYSICAL SCAN CARD TO PERFORM A SCAN

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

A. SKANNA MED DIGITAL SKANNINGSKREDIT

Att köpa krediter

HUR MAN GÖR:

- Tryck på knappen “Köp skanningskrediter”.

  Ett nytt fönster öppnas och ber dig logga in på ditt distributörskonto. Se till att du har ditt distributörs-ID, dina lösenord för Nu Skin® och kreditkort tillhanda. iPad mini ska anslutas till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna handla.

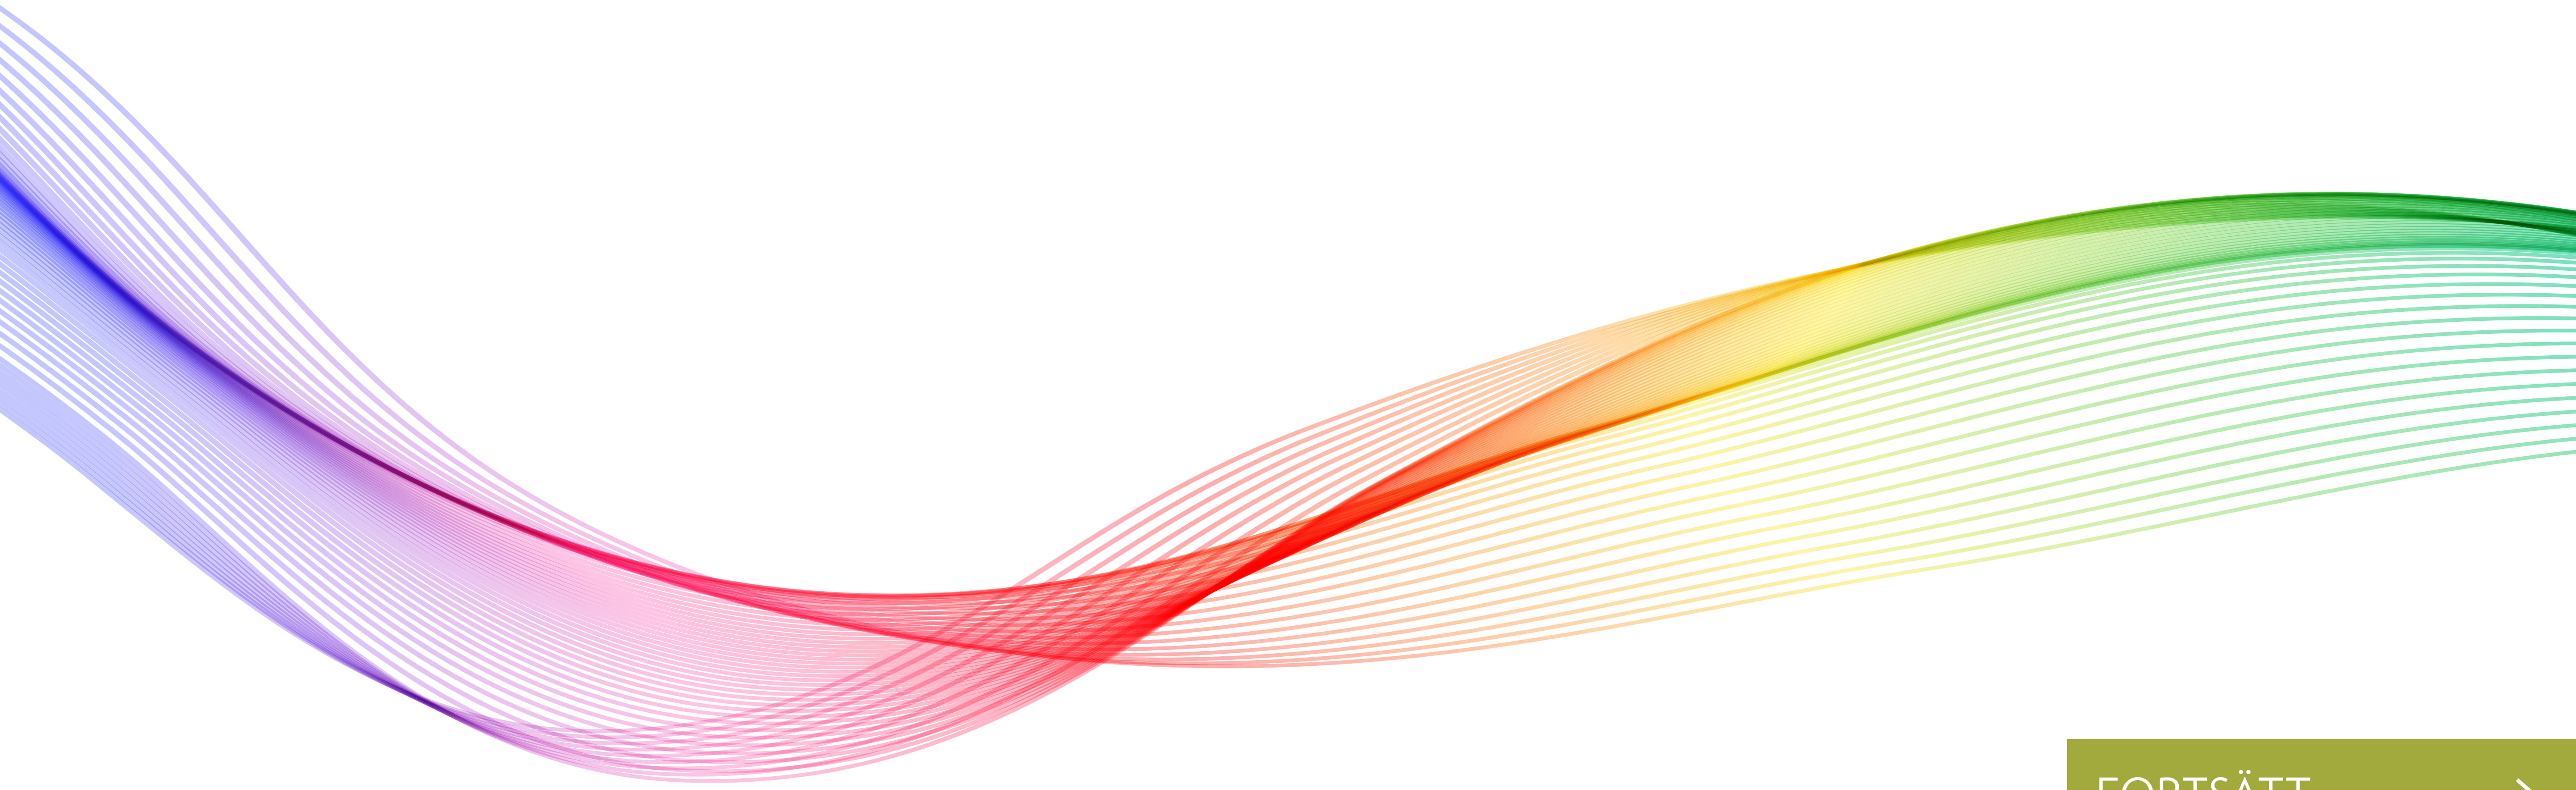

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

Skanningskrediter kan inköpas i följande antal: 1, 20 eller 100. Detta genom att trycka på lämplig ikon på skärmen.

- När du väl valt antal krediter, tryck på utcheckningsknappen för att köpa dem och lägga dem till din S3.

  Följ instruktionerna på skärmen tills dess att köpet är avslutat.

- När du är färdig, kan du stänga fönstret för köp av digitala skanningskrediter genom att trycka på ”Tillbaka” i övre högre hörnet av skärmen.

  Appen återgår till skannerfönstret.

FORTSÄTT >

- STATUSFLIKEN
- SKANNERFLIKEN
- RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

OBS!
När du har köpt skanningskrediter kan du se att ikonerna för skannerfliken och digitala skanningar har ändrats. Båda ikonerna har nu siffror som visar antalet återstående skanningar. Håll ett öga på dessa siffror så du vet när det är dags att köpa fler krediter!

Skanna digitalt

Om du har skanningskredit kvar, tryck på knappen för ”Digital skanning” och en guide öppnas automatiskt för att vägleda dig genom själva skanningsprocessen.

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

B. SKANNA MED SKANNERKORT

HUR MAN GÖR:

- Trycker du på knappen “Skannerkort” kan du antingen skanna av kortet med kameran i iPad mini eller slå in skannerkortsnumret via digitalt tangentbord.

  När skannerkortsnumret är inslaget börjar S3 Scanner App att guida dig genom skanningsprocessen.

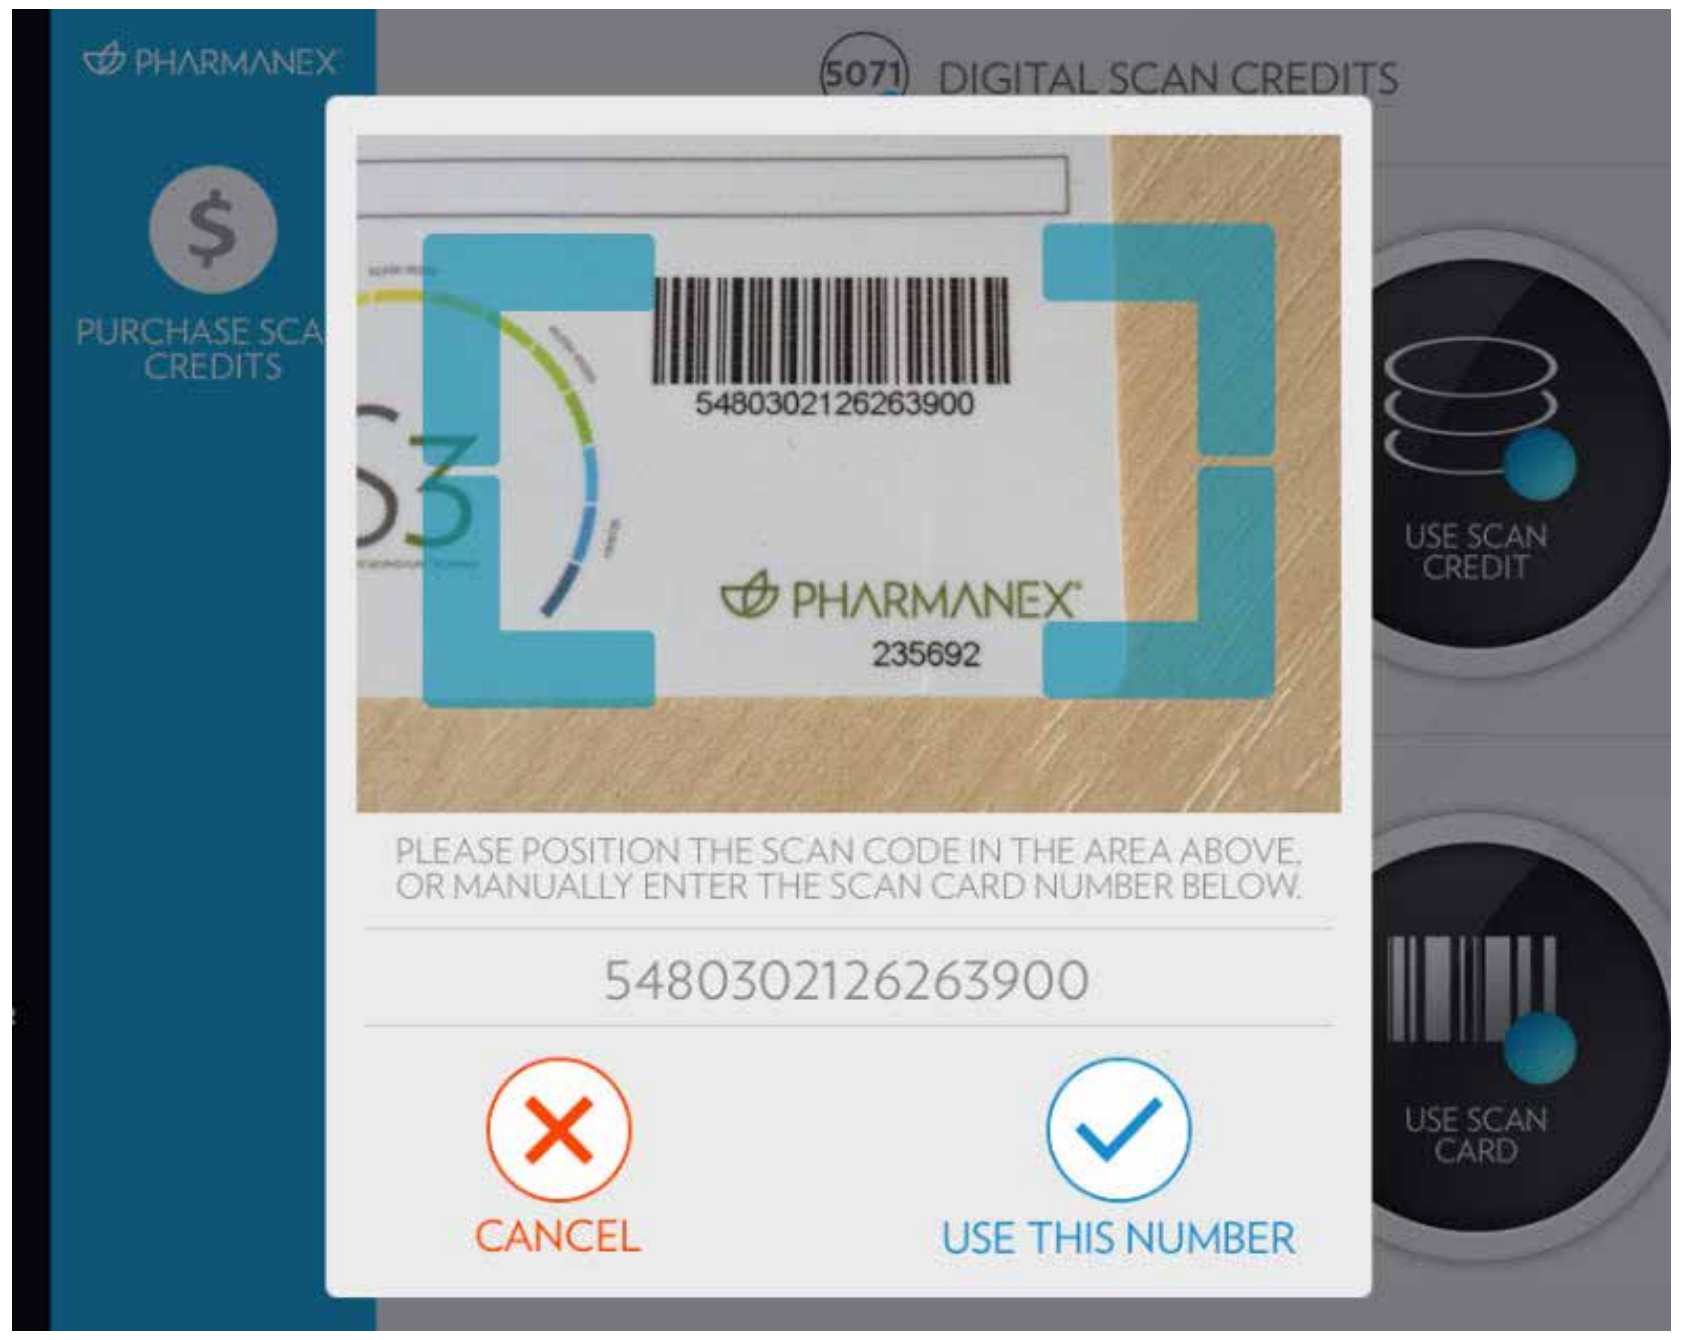
PHARMANEX
5071 DIGITAL SCAN CREDITS
PURCHASE SCAN CREDITS
USE SCAN CREDIT
USE SCAN CARD
5480302126263900
PHARMANEX
235692
CANCEL
USE THIS NUMBER

PLEASE POSITION THE SCAN CODE IN THE AREA ABOVE, OR MANUALLY ENTER THE SCAN CARD NUMBER BELOW.

5480302126263900

FORTSÄTT >

SKANNA MED S3

- STATUSFLIKEN
- SKANNERFLIKEN
- RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

› Kameralinsen är placerad i övre vänstra hörnet på baksidan av iPad mini, just under på-knappen.

VIKTIGT:
Se till att du inte skymmer linsen när du försöker skanna av kortets streckkod. När du filmar är det bäst att hålla iPad mini med händerna i nedre högra hörnen och med startskärmsknappen till höger.

FORTSÄTT ›

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

- Lägg skannerkoret på en slät yta och håll iPad parallellt ovanför kortet.

  När kortet är centrerat i kameran, känner skannerappen automatiskt av streckkoden, läser av den och går till skannerflikens fönster, redo att skanna.

- Om kameran av någon anledning inte kan avläsa streckkoden, tryck på “Skriv in skannerkort manuellt” överst till vänster.

  Då öppnas ett fält och ett digitalt tangentbord i iPad mini.

- Skriv in skannerkortsnumret i fältet med hjälp av tangenterna. Tryck ”Retur” på tangentbordet när du är färdig.

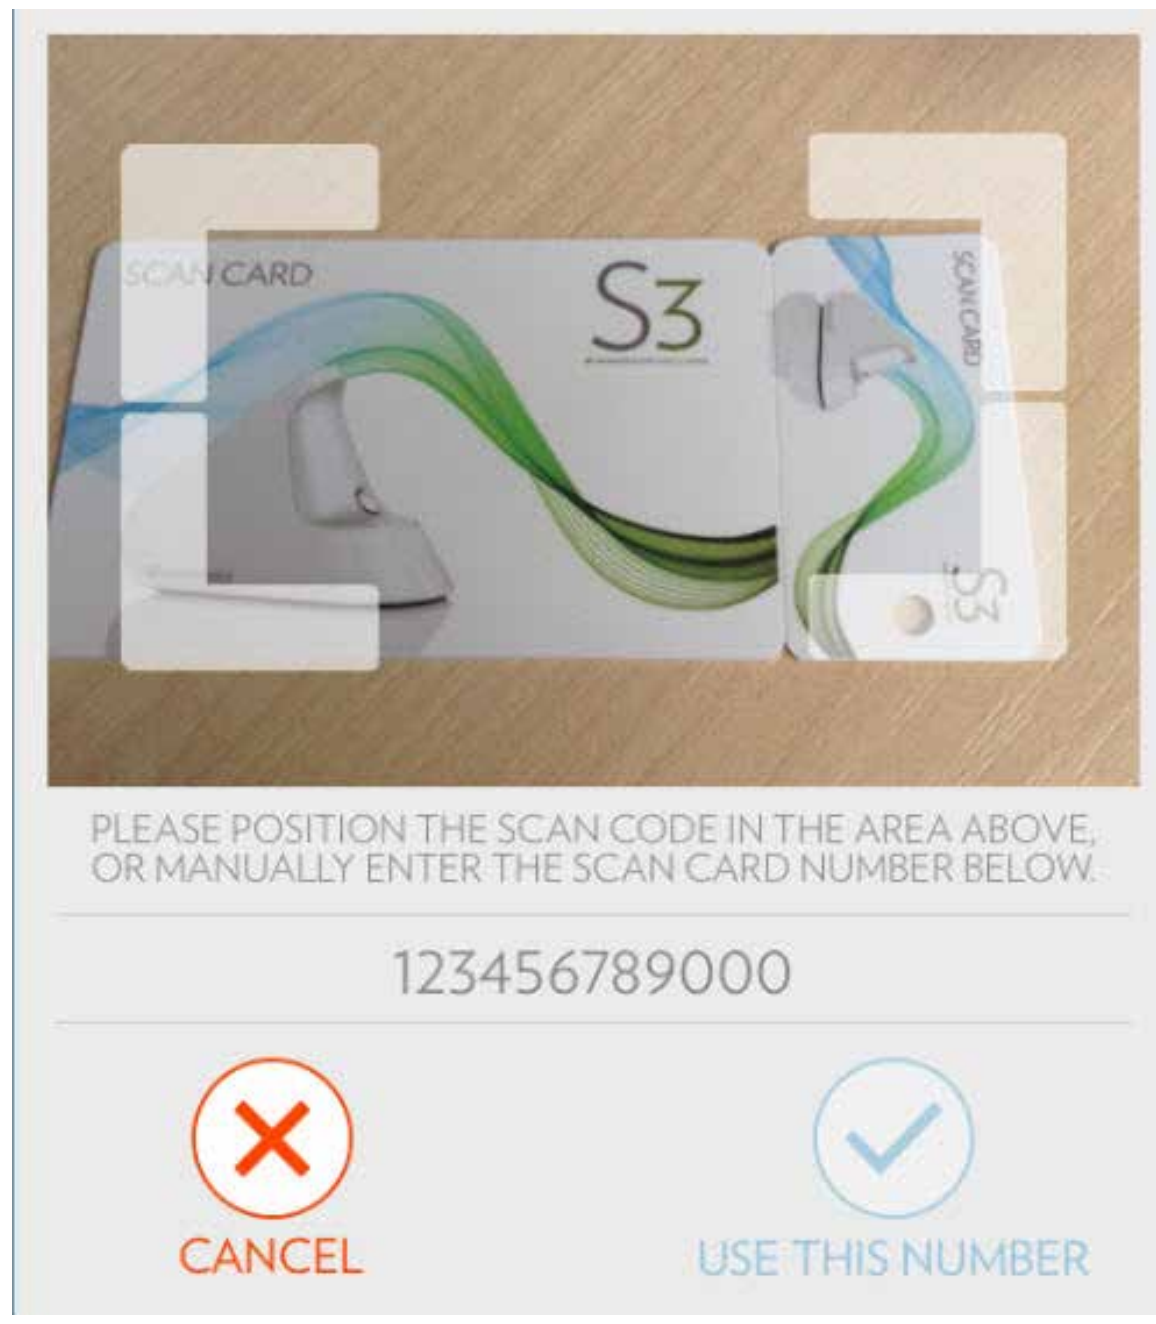

PLEASE POSITION THE SCAN CODE IN THE AREA ABOVE, OR MANUALLY ENTER THE SCAN CARD NUMBER BELOW.

123456789000

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN
SKANNERFLIKEN
RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

Appen känner igen numret och återgår till skannerflikens fönster, redo att skanna. Skriver du in felaktigt nummer får du beskedet:

”OGILTIG KOD. FÖRSÖK IGEN”.

Vill du återvända till skannerflikens fönster utan att ha läst av eller skrivit in skannerkortsnummer, tryck på ”Avbryt”.

Nu kan du börja skanna. Skriv först in personens namn i fältet ”Person som skannas”.

Därefter ombeds personen:

”PLACERA HANDEN PÅ SKANNERN”

När handen är placerad på S3:ans kon, börjar skanningen automatiskt via 3 steg:

- Igenkänning
- Initialisering
- Skanning

FORTSÄTT >

- STATUSFLIKEN
- SKANNERFLIKEN
- RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

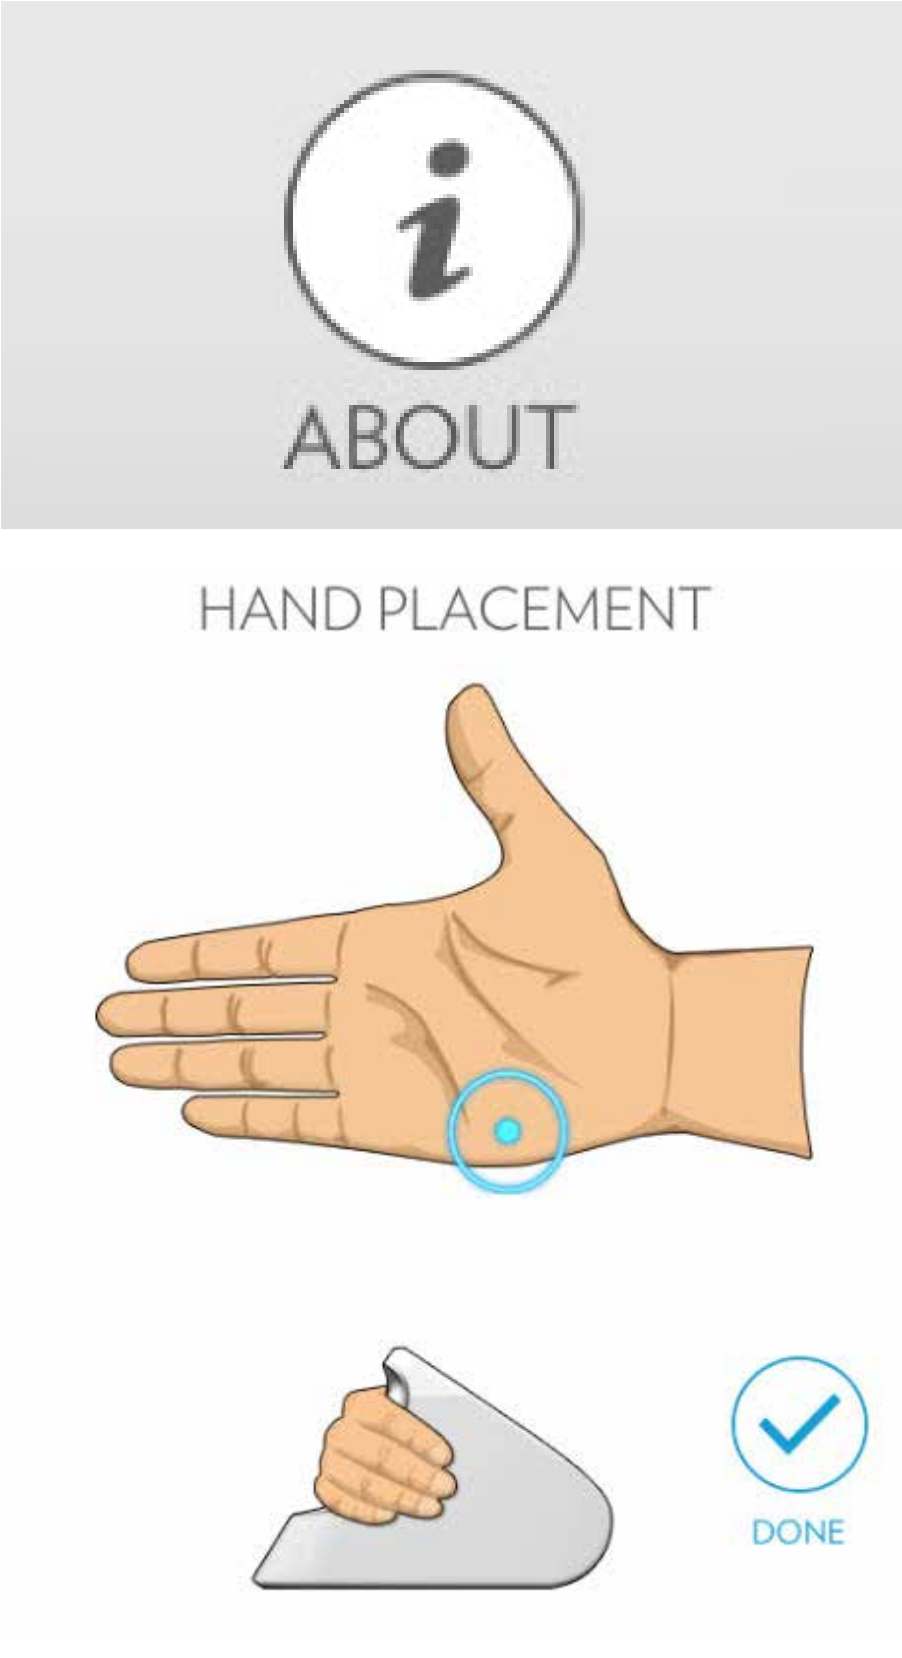

Visa hur handen ska placeras korrekt

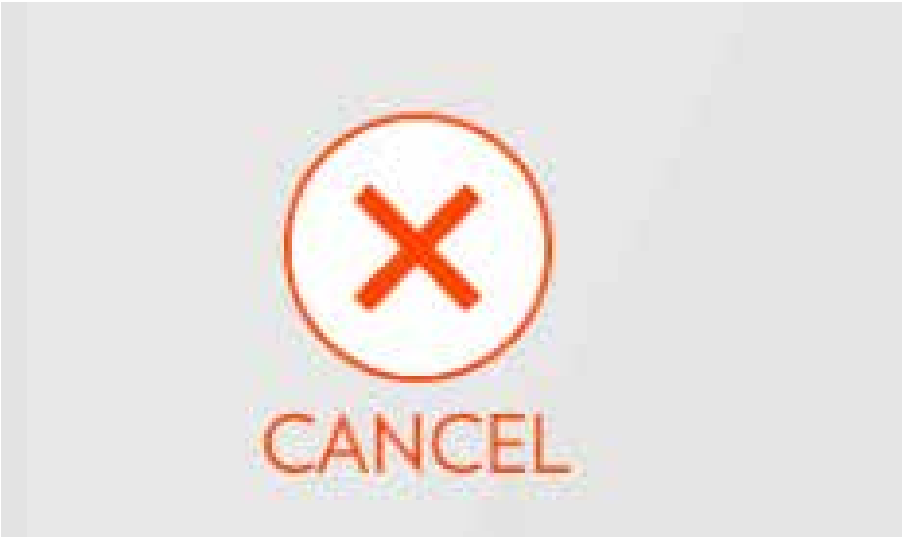

Att avbryta en skanning och återvända till skannerflikens fönster

Skanningen tar ca 30 sekunder. Handen ska ligga kvar på sonden tills dess att både appen och skannerns display visar ett mätresultat.

FORTSÄTT >

SKANNERFLIKEN

Skanningen är nu avslutad. På skärmen syns nu 2 alternativ:

- Mejla resultatet till klienten genom att skriva in dennas mejladress. Mejlet skrivs och skickas av Nu Skin Enterprises men klienten har möjlighet att svara till dig direkt.
- Skriva in demografisk information längst ned för att bättre förstå personens generella profil.

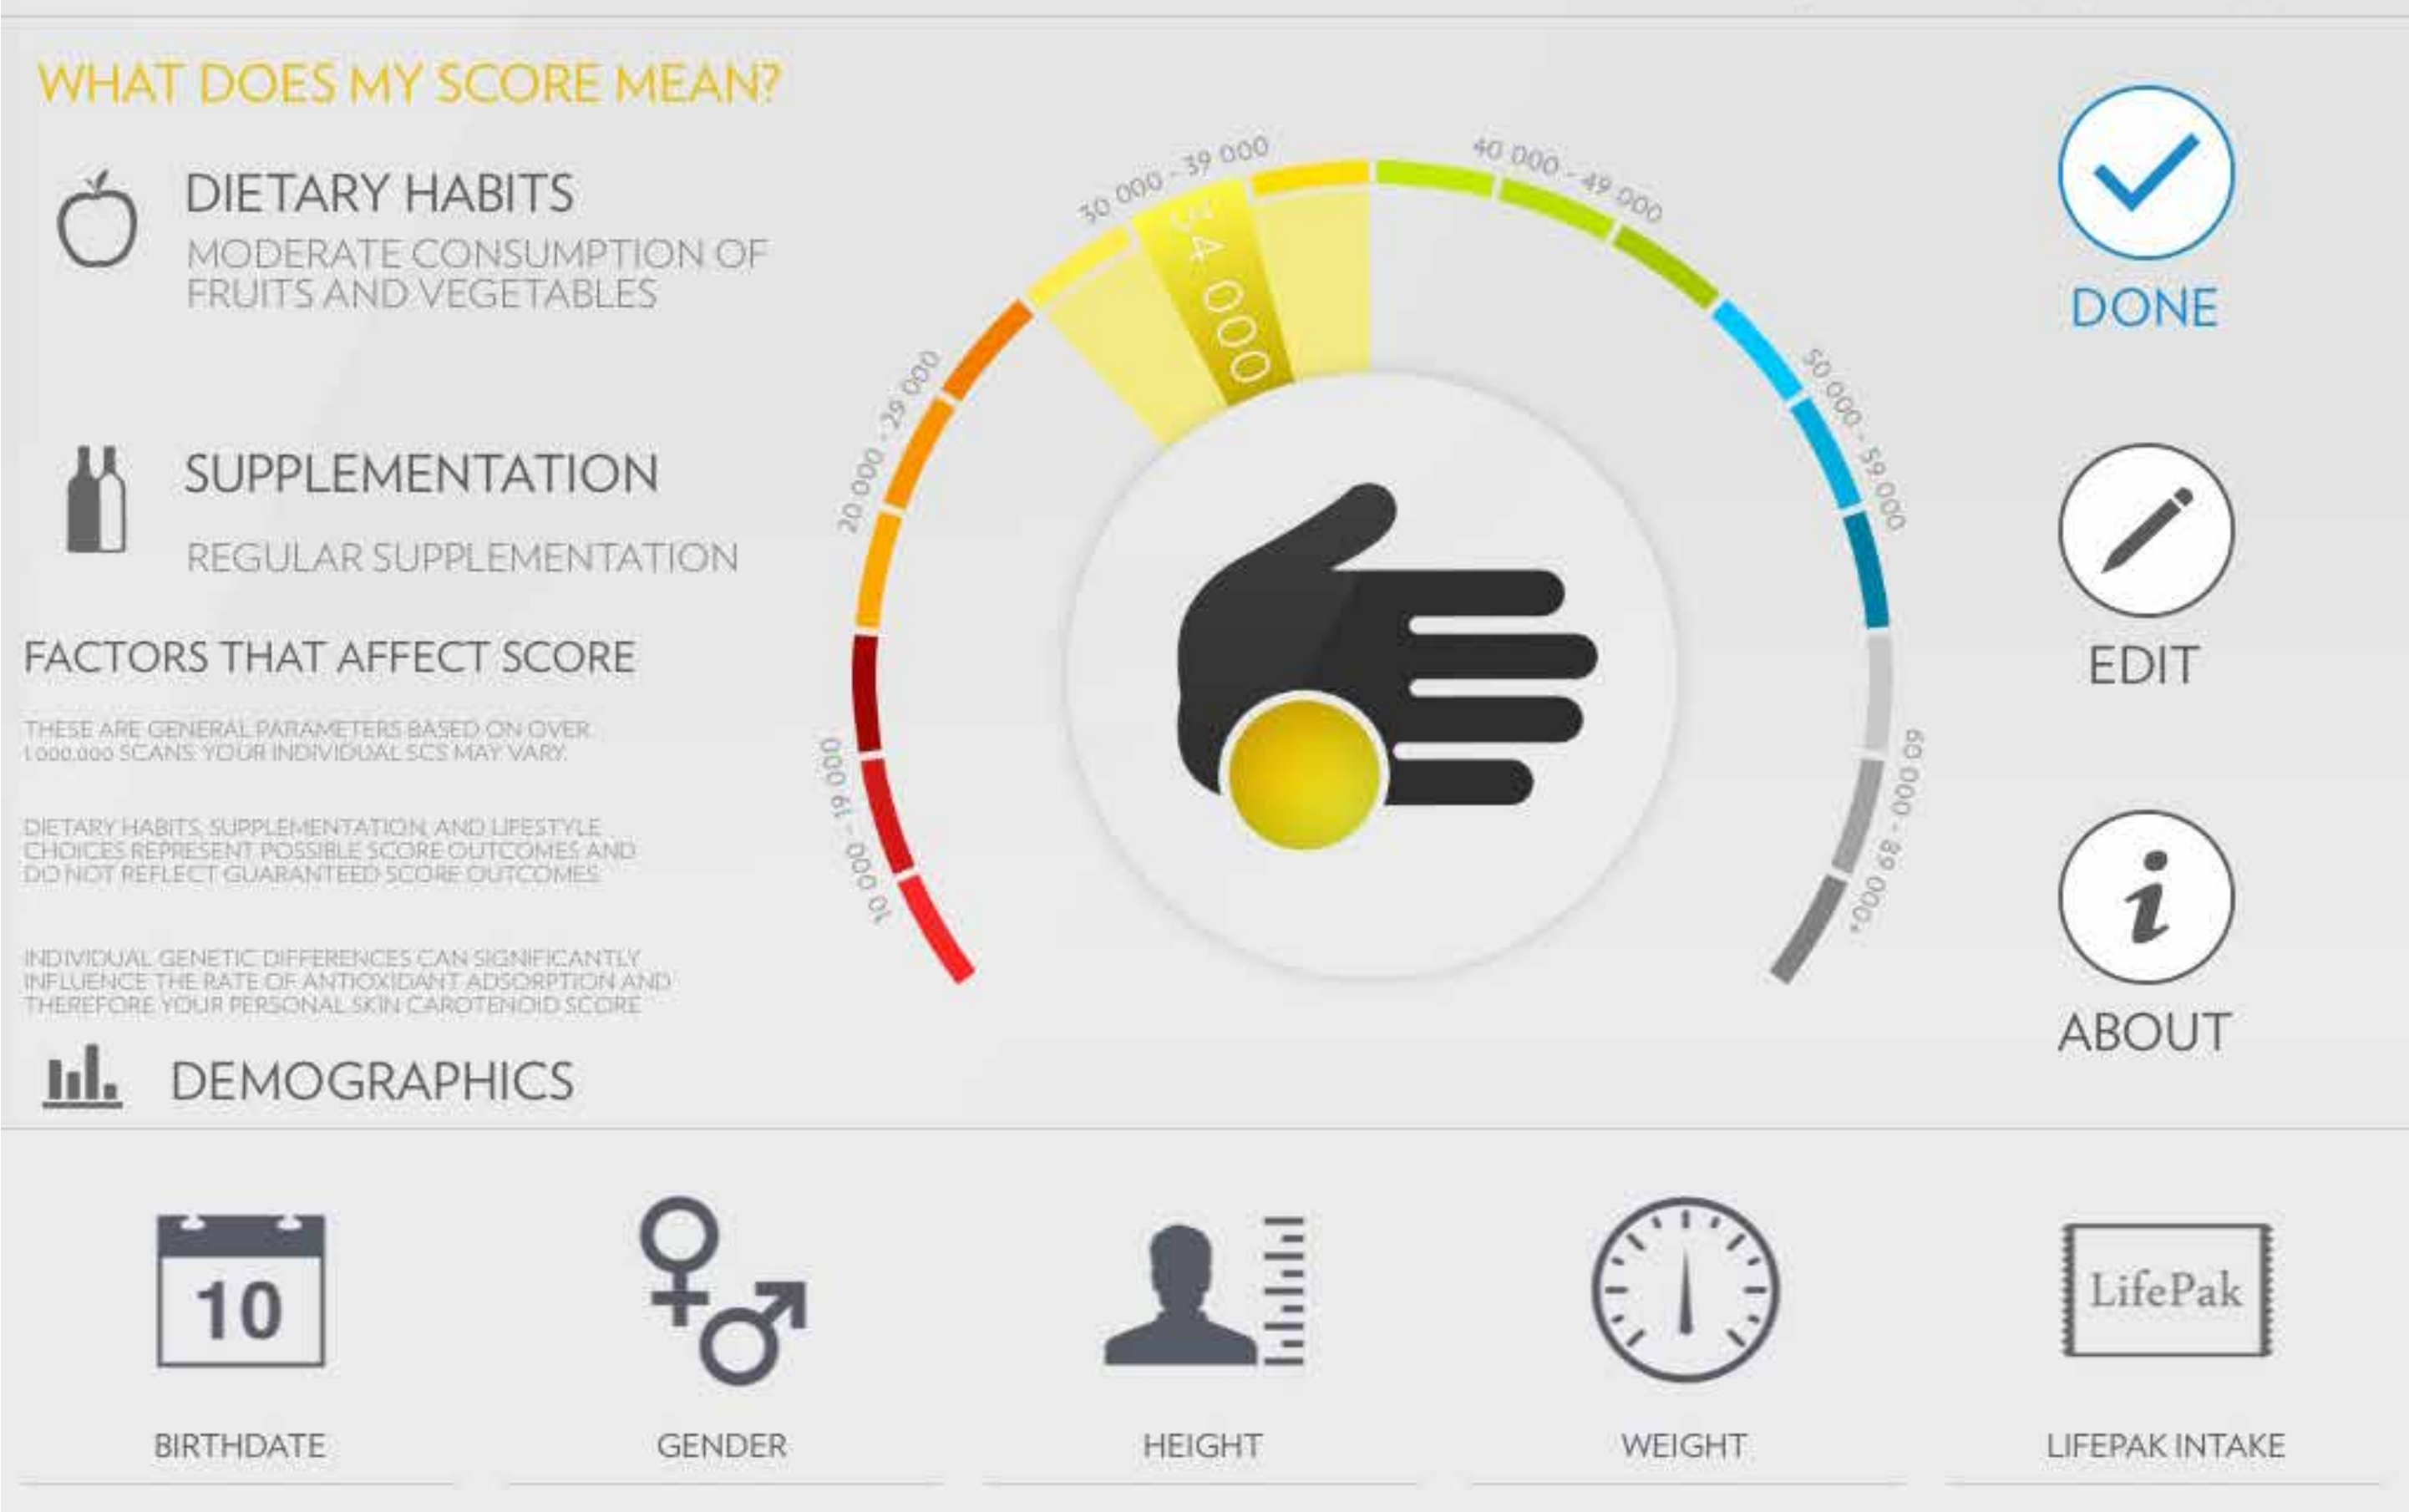

WHAT DOES MY SCORE MEAN?

DIETARY HABITS
MODERATE CONSUMPTION OF FRUITS AND VEGETABLES

SUPPLEMENTATION
REGULAR SUPPLEMENTATION

FACTORS THAT AFFECT SCORE

THESE ARE GENERAL PARAMETERS BASED ON OVER 1.000.000 SCANS. YOUR INDIVIDUAL SCS MAY VARY.

DIETARY HABITS, SUPPLEMENTATION, AND LIFESTYLE CHOICES REPRESENT POSSIBLE SCORE OUTCOMES AND DO NOT REFLECT GUARANTEED SCORE OUTCOMES.

INDIVIDUAL GENETIC DIFFERENCES CAN SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE RATE OF ANTIOXIDANT ADSORPTION AND THEREFORE YOUR PERSONAL SKIN CAROTENOID SCORE

DEMOGRAPHICS

10 000 - 19 000
20 000 - 29 000
30 000 - 39 000
34 000
40 000 - 49 000
50 000 - 59 000
60 000 - 89 000
DONE
EDIT
ABOUT
10
BIRTHDATE
GENDER
HEIGHT
WEIGHT
LifePak
LIFEPAK INTAKE

FORTSÄTT >

SKANNA MED S3

STATUSFLIKEN

SKANNERFLIKEN

RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

SKANNERFLIKEN

För att avsluta skannersessionen, tryck ”Färdig” så återgår du till startsidan där du antingen väljer digitala skanningskrediter eller skannerkort.

När du väl tryckt att du är klar kan du inte längre gå tillbaka till kundens resultat.

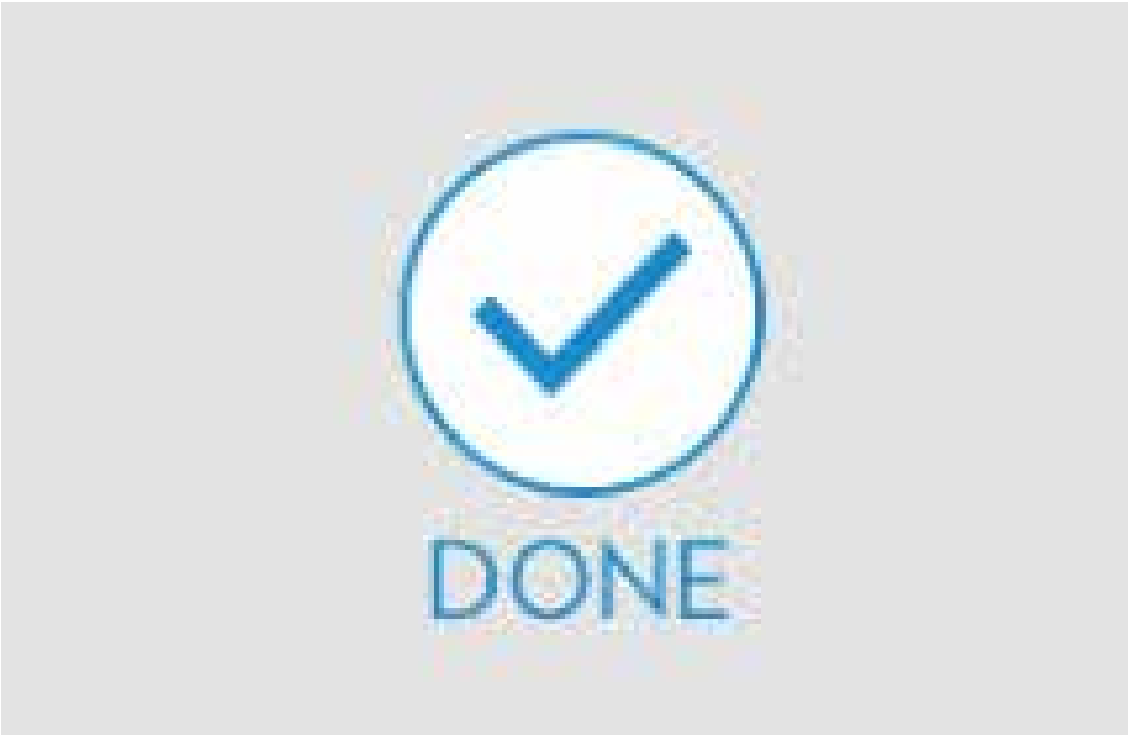

FORTSÄTT >

STATUSFLIKEN

SKANNERFLIKEN

RESULTATSKÄRMEN – DEMOGRAFIN

RESULTATSKÄRMEN - DEMOGRAFIN

När du trycker på en ikon aktiveras menyer där du kan välja vad som bäst passar in på personen. Informationen hjälper Nu Skin® med profiler och statistiska data.

Man behöver inte skriva in demografiska data för att få mätresultatet, det är frivilligt. Dock vill vi uppmuntra till att samla in så mycket information som möjligt om varje person vid varje skanningstillfälle. Var så noggrann som möjligt när du skriver in informationen. Det är viktigt för att statistiken ska bli meningsfull.

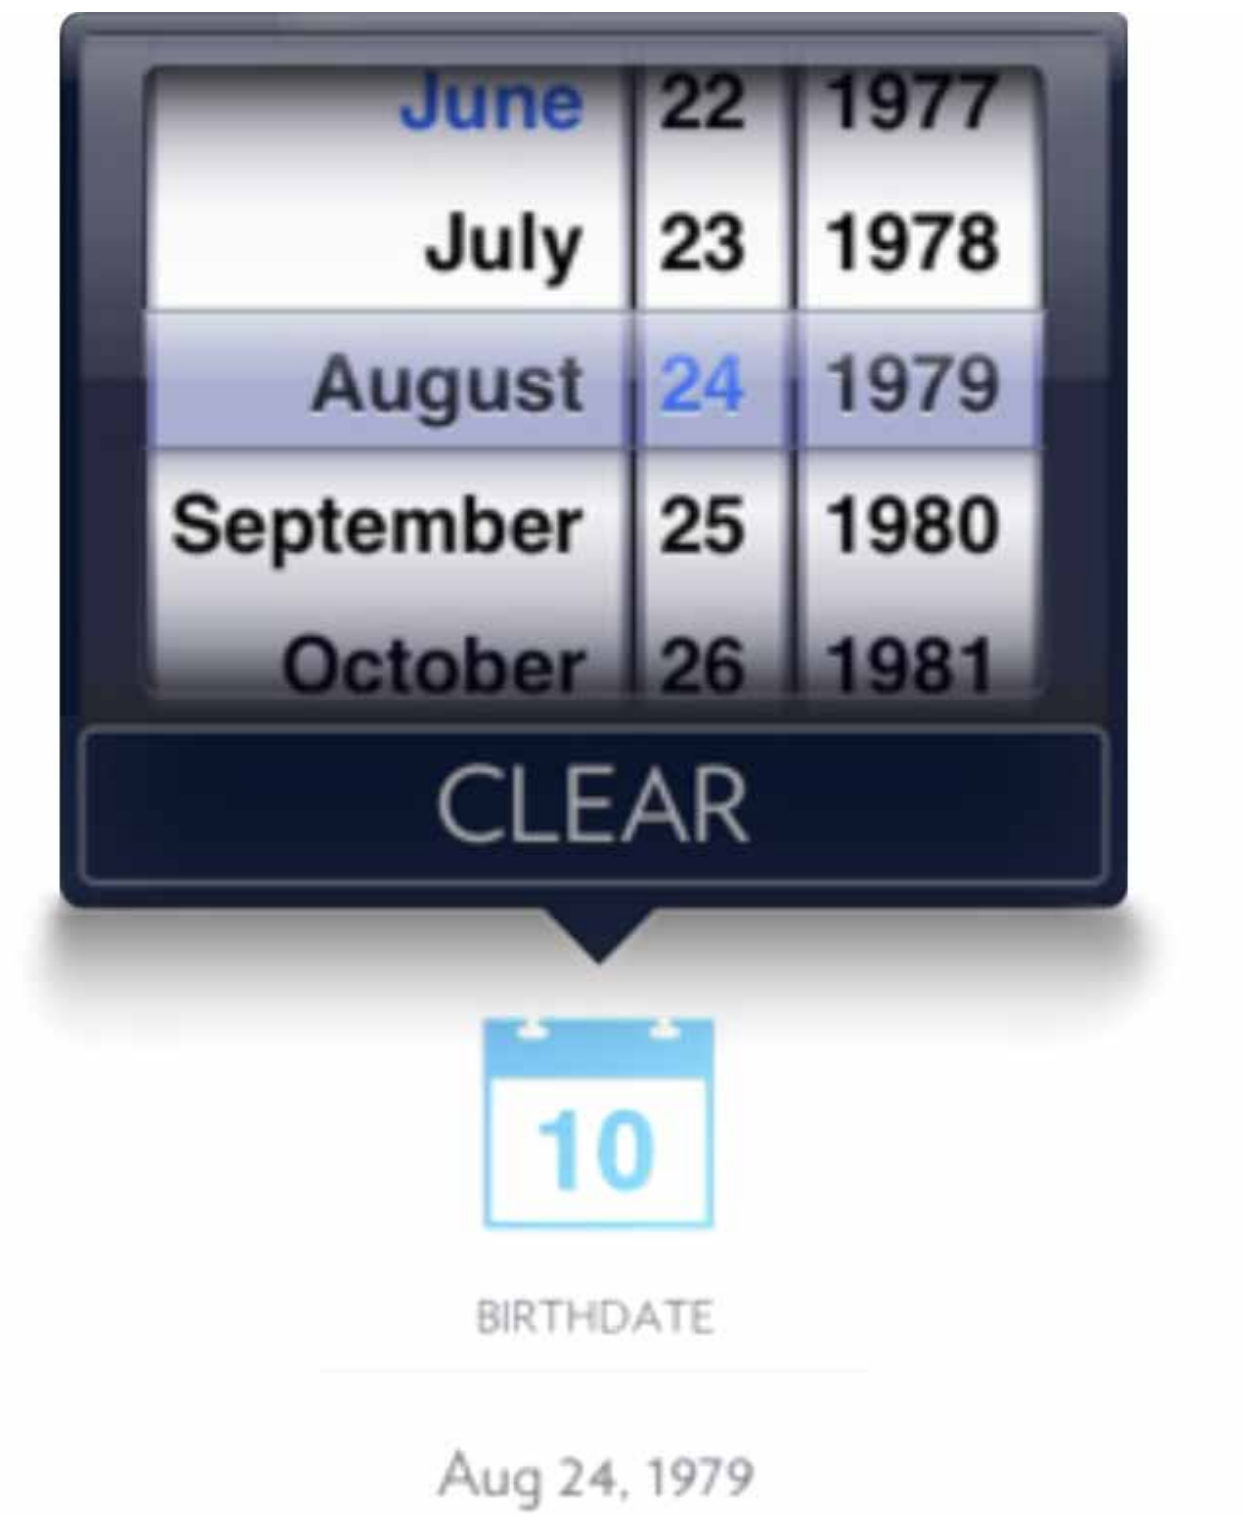
June 22 1977
July 23 1978
August 24 1979
September 25 1980
October 26 1981
CLEAR
10

BIRTHDATE

Aug 24, 1979

FORTSÄTT >

SYNKRONISERA S3

RECORDS

S3 Scanner App sparar en digital kopia av alla dina skanningar i Rapportfliken. Tryck på fliken för registrerade för att öppna dess fönster. En lista över alla skanningar i kronologisk ordning efter datum och tid syns (senaste skanning överst).

Ibland kan det stå ”Pågående” eller ”Registrerat” efter skanningen. Detta visar om registreringen synkroniserats med Nu Skins server eller ej. En synkad registrering visas som registrerad medan en pågående betyder att den ännu inte synkroniserats.

För att synkronisera fullständiga skanningsresultat med Nu Skins server, måste du vara kopplad till ett trådlöst nätverk.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

FORTSÄTT >

SYNKRONISERA S3

RECORDS

VIKTIGT:
Du måste synkronisera S3 Scanner App med Nu Skins server minst en gång i månaden och aldrig senare än sista dagen i månaden. Gör du inte detta, räknas inte skanningarna in i dina bibehållandekrav, fria program, PSV och provisioner. Vi rekommenderar att du synkroniserar efter varje skanning.



För att synkronisera dina registreringar, tryck på ”SYNKRONISERING”

Operatörsfliken

Använd fliken för att ändra session eller välj marknad och språk.

FORTSÄTT >

43,000
CS70136
20V 2A

STÄNG AV S3

- Koppla först ned Scanner App genom att gå till statusfliken och klicka på avstängningsknappen.
- Gå ur S3 Scanner App genom att trycka på startskärmen i iPad.
- Stäng av iPad-skärmen genom att trycka snabbt på strömbrytaren.
- Släng av S3 genom att trycka på strömbrytaren på baksidan. Tryck inte på Bluetooth-knappen i avstängt läge. Det behövs inte.
- Sätt på linsskyddet för att skydda från skador.
- För att koppla bort S3:an från strömförsörjningen, dra ut adaptern från kontakten på baksidan. När S3:an är ansluten till elnätet, håll adaptern och bakre kontakten lätt åtkomliga hela tiden.
- Förvara skannern i väskan när den inte används.

VIKTIGT:
Stäng aldrig av S3 när den skannar eller används för övrigt. Kör du skannern på batterier och displayen visar att dessa börjar ta slut, koppla antingen till eluttag eller stäng av apparaten.

FORTSÄTT >

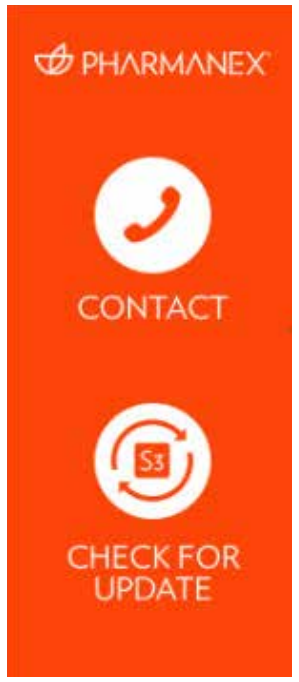
PHARMANEX
CONTACT
CHECK FOR UPDATE

SUPPORT

- Under KONTAKT kan du se mejladresser till din lokala skannersupport och länkar till webbsidor där du kan få hjälp.
- I OM kan du se vilken version du har av S3 Scanner App samt annan information om hård- och mjukvara.

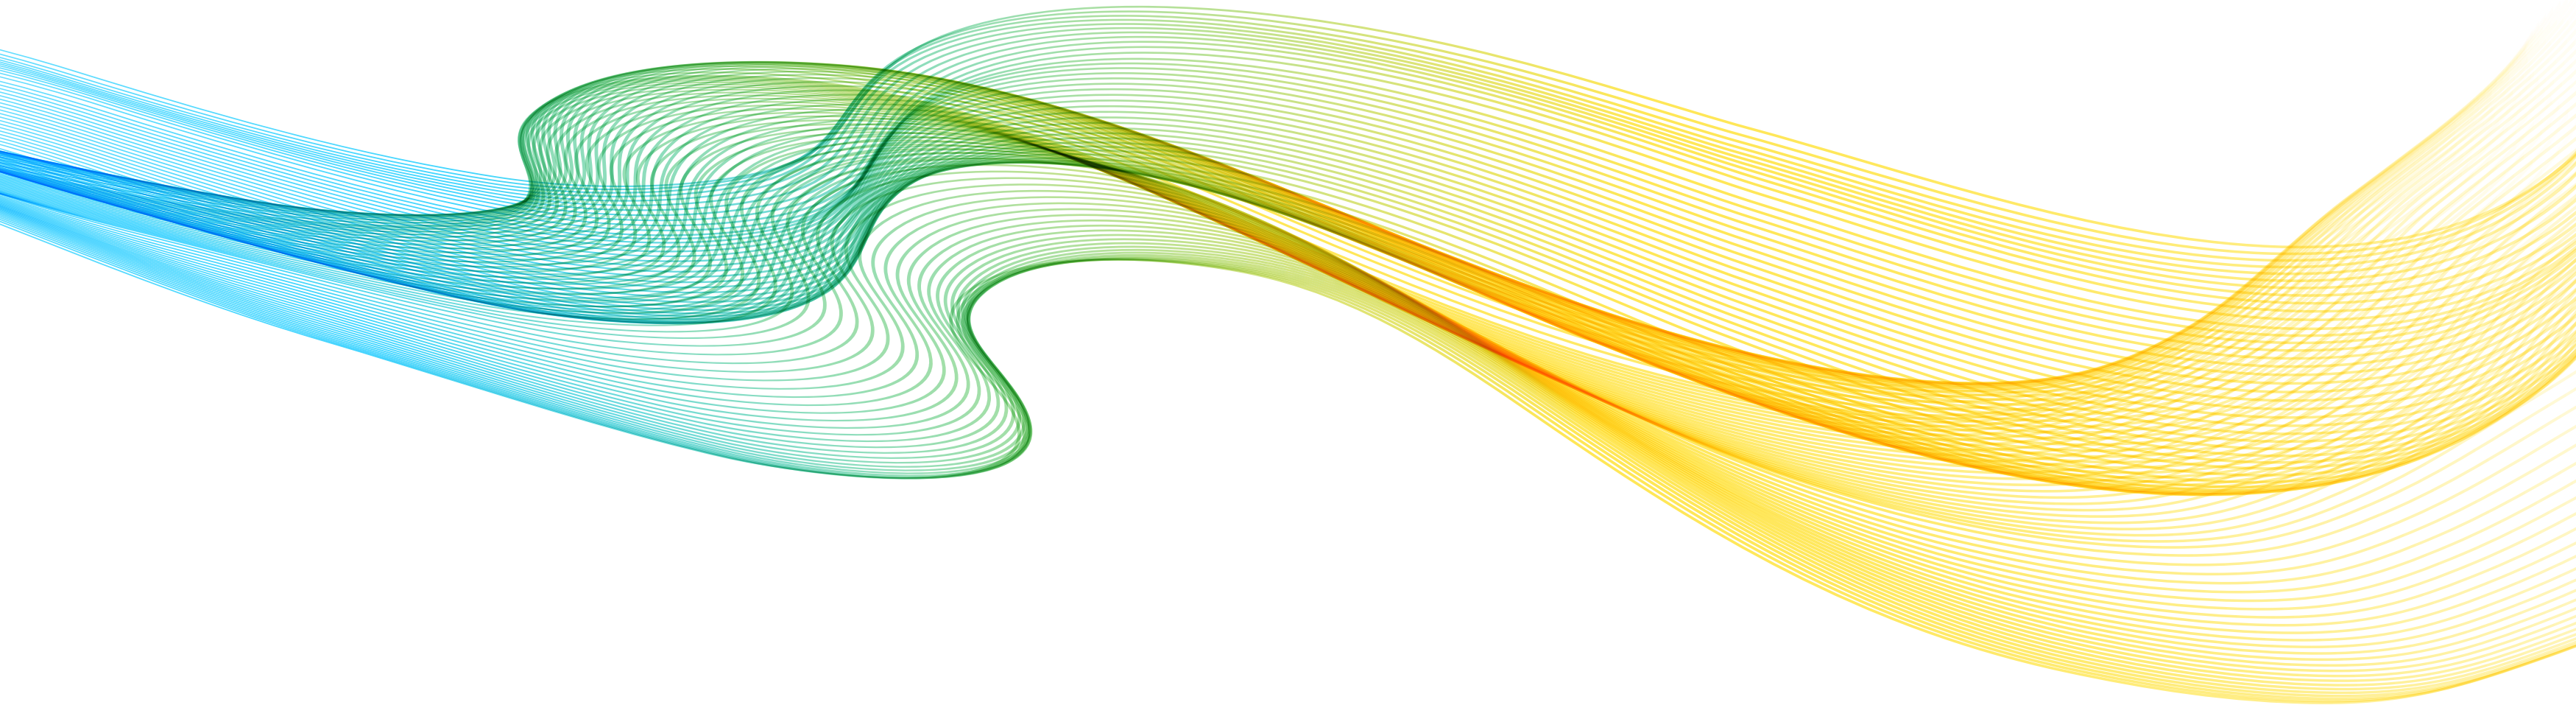

FORTSÄTT ›

TIPS & RÅD

S3 Scanner App startar inte när jag trycker på startskärmen.

- Pressa och håll app-ikonen på startskärmen. Avinstallera appen och återinstallera den på nytt genom att följa instruktionerna i denna manual. **Det här ska du bara göra som en sista utväg, då detta raderar alla oanvända skanningskrediter du har köpt och det raderar också alla ev. icke-synkroniserade skanningsresultat.**

S3 Scanner startar inte.

- Se till att du har laddat skannern i minst 8 timmar innan du försöker sätta igång den.
- Koppla S3 till vägguttag med hjälp av medföljande nätsladd. Den bakre LED-lampan ska nu lysa grön för att visa att apparaten laddas. Huvuddisplayen ovanpå S3 ska också visa en laddningssymbol. Tryck och håll strömknappen i minst 5 sekunder. Släpp knappen och tryck sen på den igen.

FORTSÄTT >

TIPS & RÅD

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Det går inte att skanna med S3 Scanner App.

- Anledningarna kan vara flera:
  - Skannern kanske inte är kopplad till iPad mini via Bluetooth.
  - Se till att iPad mini och skannern är inom räckhåll för varandra (inom 30 m).
  - Du kan behöva göra en skanning med lock eller en operatörsskanning. Se statusfliken ang. detta.
  - Se till att du synkroniserar skannern minst en gång per månad.
  - Se till att du har köpt digital skanningskredit eller har läst in ett skannerkort.
  - Se till att du skrivit in personen i skannerflikens fönster.

När jag försöker använda ett skannerkort läser inte kameran av numret korrekt.

- Skriv in numret manuellt i textfältet genom att använda det digitala tangentbordet.

FORTSÄTT >

TIPS & RÅD

S3 Scanner App säger att skannerkortet är ogiltigt.

- Skannerkortet har antagligen redan använts. Använd ett annat skannerkort eller köp skanningskredit via skannerfliken.

Var finner jag mina fullgjorda skanningar i appen?

- Appen har en lista över dessa under registerfliken.

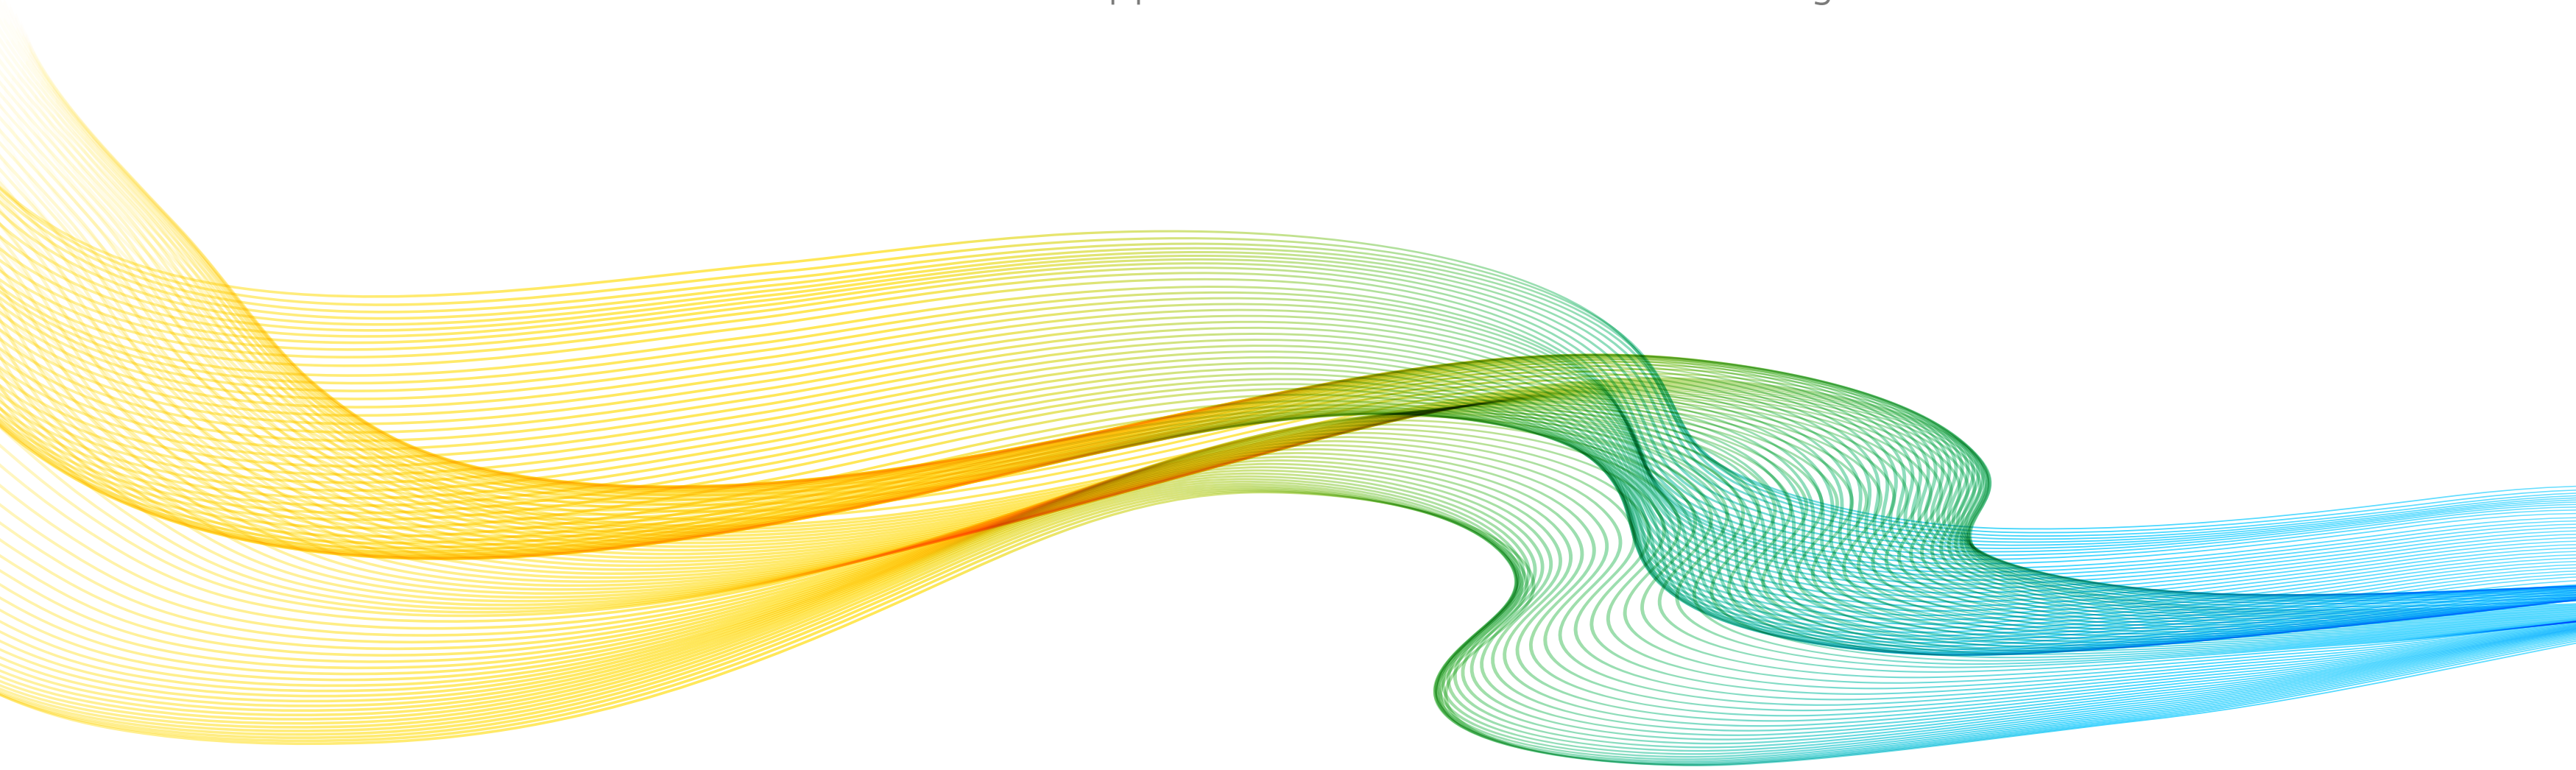

FORTSÄTT >

TIPS & RÅD

SYNKRONISERING

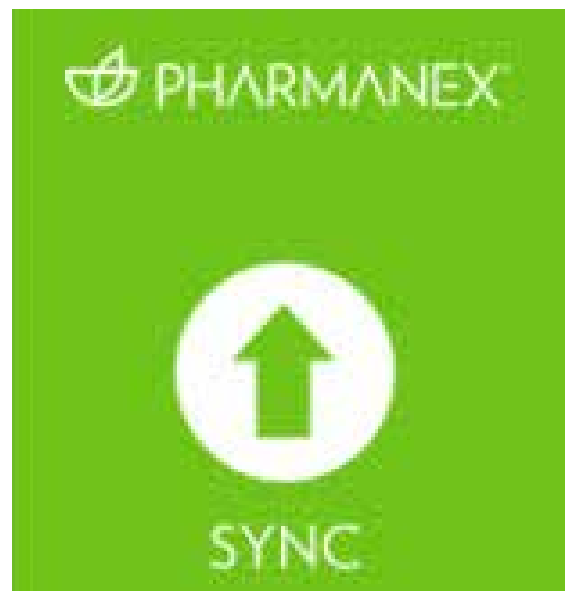

Se till att iPad mini är ansluten till ett Wi-Fi.

Om felmeddelande säger att servern inte svarar, vänta i 10 min. och försök synkronisera igen. Kommer felmeddelandet åter upp, kontakta lokal skannersupport.

Om tiden för synkronisering löpt ut, tryck på synk-knappen. Detta gör att skanningstiden laddas på nytt.

LOCK

Linsskyddet, eller locket, är till för att skydda själva konen på skannern. Ha detta på när du inte skannar och mellan varje skanning.

RENGÖRING

Vi har alla olja i huden så efter upprepade skanningar kan dessa beläggningar påverka skannerapparatens avläsning. Gör regelbundet ren konen och framsidan av skannern. Dra först ut sladden till S3:an. Använd sedan en mikrofibertrasa med glasrengöring eller mild tvållösning med vatten. Torka varsamt av apparaten. Dränk inte in S3:an i vatten eller sköljvatten för att göra ren den. Använd inte starka kemiska rengöringsmedel eller medel med slipeffekt. Dessutom rekommenderar vi att de du skannar använder Nu Skin® Epoch® Hand Purifier innan skanningen för att minska beläggningar på S3:an och potentiell överföring av bakterier mellan människor.

FORTSÄTT >

TIPS & RÅD

VARIABILITET

Variabler är vanliga då skannern mäter karotenoider, vilka finns på spårnivå och i mänsklig vävnad.

Två faktorer påverkar SCS-mätningen.

1. Den personliga (gener, kosthållning och livsstil).
2. Den tekniska (kalibrering, temperatur, handplacering, dragiga lokaler) 85 % av alla mätningar kommer att vara +/- en färgnyans från medelvärdet.

Se till att skannen fungerar direkt genom att:

- Kontrollera att den som skannas har handflatan exakt placerad som vid tidigare skanningstillfälle.
- Kontrollera att skannern är kalibrerad med hjälp av locket och operatörsskanningen.
- Skanna i rum där temperaturen håller 20-25° C.

FORTSÄTT >

TIPS & RÅD

BLUETOOTH

Tips om hur du behåller Bluetooth-anslutningen:

1. Stäng inte av skannern medan S3 Scanner App fortfarande är igång.
2. Tryck inte ned Bluetooth-knappen på baksidan av skannern när du väl anslutit. Detta återställer Bluetooth-anslutningen och kan ibland orsaka avbrott i signalerna.

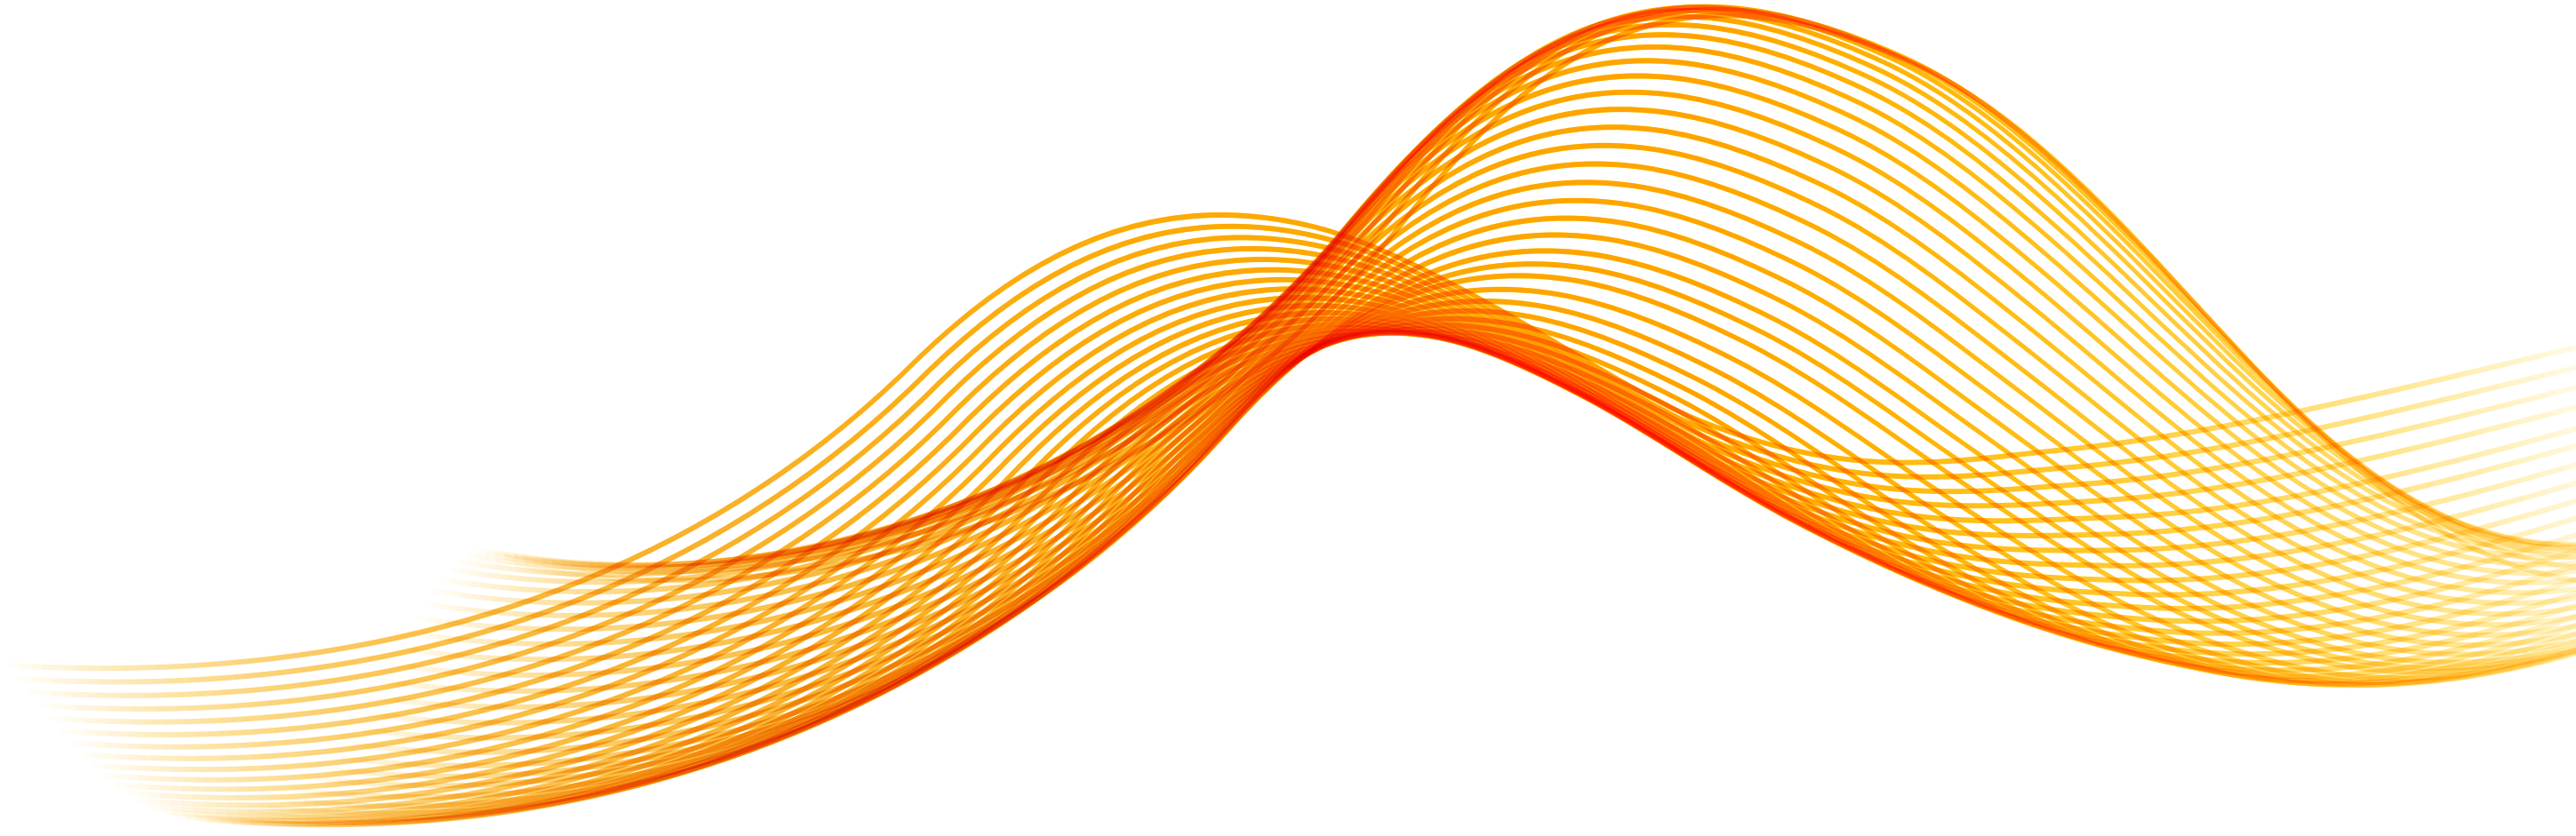

FORTSÄTT >

TIPS & RÅD

BLUETOOTH

Kan du inte ansluta till Bluetooth, försök först STARTA OM Bluetooth:

1. Tryck in Bluetooth-knappen på baksidan av skannern i 5 sekunder tills den blinkar.
2. Avsluta appen på normalt vis.
3. Starta om S3 Scanner App, kontrollera statusfliken och se om utrustningen återkopplat till iPad.
4. Om delarna inte ansluter, gå ur appen och tryck på ikonen för INSTÄLLNINGAR.
5. Slå av Bluetooth. Vänta 2-3 sekunder. Slå sedan på Bluetooth-knappen igen.
6. Ladda S3 Scanner App igen och se om anslutningen återupptagits.
7. Fungerar inte detta, följ stegen på nästa sidan för att STARTA OM.

FORTSÄTT >

TIPS & RÅD

STARTA OM

- Stäng S3-appen
- Stäng av skannern genom att trycka på strömbrytaren i 3 sekunder
- Stäng ned iPad genom att trycka på av/på-knappen i 5 sekunder och dra den röda pilen när den visar sig
- Slå på iPad igen
- Lokalisera och tryck på inställnings-ikonen
- Tryck på Bluetooth för att avaktivera denna
- Vänta i 3 sekunder och aktivera den igen
- Slå på skannern igen
- Håll ned Bluetooth-knappen i 5 sekunder tills den blinkar
- Öppna S3 Scanner App
- Försök ansluta till skannern

FORTSÄTT >

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Spänning eller spänningsvidd : endast med matning DOC EMSA 200/200
  - – Ingång 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A
  - – Utgång 20 V, 50-60 Hz, 2,0 A
- Sammanställning av miljöförhållanden
  - – Användning inomhus upp till 2000 m
  - – Säker drifttemperatur: 10° – 40°C
  - – Optimal drifttemperatur: 20° – 25°C
  - – Säker lagringstemperatur: 10° – 40°C
  - – Relativ fuktighet: 18 – 85 %
  - – Nätspänning: +10 % till -10 %
- EMC: 61326-1:2013; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-3-2:2006
- Säkerhet: 61010-1:2010
- Vikt: (1,46 kg)
- Höjd: (16,8 cm)
- Bredd: (23,5 cm)
- Djup: (11,6 cm)

Namn och adress till representant inom EU:
Nu Skin Belgium N.V.
Leonardo Da Vincilaan 9
1935 Zaventem – Belgien

För att kontakta din lokala skannersupport, gå via S3:s App, avsnitt Support>Kontakt

FORTSÄTT >

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktens CE-märkning visar att tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med EU-direktiven 2006/95/EC, 2004/108/EC och 1999/5/EC.

Symbolen anger att enheten finns listad hos Underwriters Laboratories.

Symbolen anger att enheten finns listad hos Canadian Standards Association.

Inga utbytbara delar inuti. Alla komponenter är skräddarsydda och får inte manipuleras på något sätt. Garantin gäller ej om etiketter avlägsnas, skadas eller på annat sätt ändras.

Symbolen betyder att enheten inte ska avyttras av konsumenten. Den ska sändas tillbaka till Pharmanex® LCC för avyttring.

S3 är digital utrustning enligt klass B och överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) utrustningen får inte orsaka skadliga störningar och (2) utrustningen accepterar alla mottagna störningar, även oönskade sådana under hanteringen.

Överensstämmer med restriktionerna för användning av farliga ämnen (direktiv 2011/65/EC).